



PUBBLICAZIONE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DETERMINA N 942 DEL 26 OTT. 2016

OGGETTO: Affidamento tramite Mepa della fornitura di lampade scialitiche per diverse UU.OO. del P.O. "Umberto I" di Enna. *PROG. SL*

U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO

Proposta determina. N 106357 del 07 OTT 2016

Il Funzionario Istruttore
(*Dr. Francesca La Paglia*)
[Signature]

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Direttore U.O.C.
Provveditorato-Economato

Dr. Libera F. Carta *[Signature]*

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:
come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente determina.

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. _____

Il Responsabile del procedimento

IL DIRETTORE DEL SEFP

F.00

Data ricezione proposta presso Ufficio delibere _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.C. PROVVEDITORATO - ECONOMATO

L'anno duemilasedici il giorno 26 OTT. 2016 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, a seguito di atto di "ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato" - Prot. N° U 2015 - 0009079 D.G. del 24/04/2015

VISTO il Dlgs n°502/92 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n°5/2009;

VISTA la delibera n°1 del 22 settembre 2009, con la quale è stato approvato l'atto costitutivo dell'ASP di Enna;

VISTO l'Atto Aziendale approvato in via definitiva con atto n°2556 del 23.09.2010;

VISTO l'art. 7 del Regolamento Aziendale, adottato con delibera 1412 del 23 luglio 2013 ex D.A. n. 01283 del 03 luglio 2013, che regolamenta le acquisizioni in economia di beni e servizi;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di questa A.S.P., che all'art.34 stabilisce le attività della U.O.C. Servizio Provveditorato e le competenze conseguentemente attribuite al Responsabile del predetto Servizio;

VISTO l'atto di ricognizione prot. n°U 2015 – 0009079 D.G. del 24/04/2015 del Direttore Generale, avente per oggetto "Ricognizione competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato" che conferma le competenze del Direttore della UOC Servizio Provveditorato, definite nei superiori atti normativi e regolamentari alle quali afferisce l'adozione della presente determina;

VISTE le note del 16.10.2015 del 29/02/2016 e del 16.03.2016, vistrate positivamente dalla Direzione Sanitaria, con le quali rispettivamente i Responsabili delle UU.OO. di Dermatologia, Chirurgia e Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Umberto I" di Enna chiedono l'acquisto di n.6 lampade scialitiche, in sostituzione di quelli esistenti, guaste e non più riparabili, essendo di vecchia generazione e ne trasmettono le caratteristiche tecniche;

DATO atto che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul *ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)* apposita procedura sottosoglia, tramite l'invio di *una RDO (richiesta di offerta)*, n°1151273 del 17.03.2016, invitando tutte le ditte che operano nel territorio Italiano e nel settore di cui è questione, iscritte al *ME.PA*;

VISTO il verbale di aggiudicazione del 05/09/2016 da cui si evince che entro il termine ultimo del 13.04.2016, sono pervenute cinque offerte da parte delle seguenti ditte:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) Grimed s.r.l. | P.I. 02835291200 |
| 2) Maquet Italia | P.I. 03992220966 |
| 3) Odontoiatrika Service Point s.r.l | P.I. 02748570849 |
| 4) Ultramed s.r.l. | P.I. 02732230871 |
| 5) Zovam s.r.l. | P.I. 01466990858 |

Che in data 27 giugno 2016 è stata richiesta la demo a tutte le Ditte partecipanti da effettuare entro le ore 12,00 dell'11/07/2016;

Che la demo è stata effettuata solamente dalle Ditte Grimed, Maquet e Ultramed per cui le Ditte Odontoiatrika e Zovam sono state escluse dalla continuazione della gara;

VISTO il parere di conformità del 30/08/2016 relativamente alla voce n.1

VISTO il parere di conformità del 08/09/2016 relativo alla voce n.2

VISTO il parere di conformità espresso dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica in data 21/09/2016 a seguito del riesame della campionatura presentata dalle Ditte Maquet, Ultramed e Grimed;

CHE sulla base dei pareri espressi e delle offerte economiche, di seguito si riportate, si è proclamata l'aggiudicazione in favore della Ditta Ultramed che, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, ha offerto il prezzo più basso :

- Ditta Ultramed al prezzo complessivo di €.22.240,00 + Iva
- Ditta Grimed al prezzo complessivo di €.23.360,00 + Iva;
-

ATTESO che con nota del 05/10/2016 è stata richiesta alla Ditta Ultramed una miglioria sui prezzi offerti e vista la nota di riscontro con cui la Ditta ha dichiarato la disponibilità ad applicare un'ulteriore miglioria del 2% sull'importo totale che , pertanto, si viene a rideterminare in €.21.795,20 + Iva;

RITENUTO, alla luce del parere e dei prezzi offerti di affidare la fornitura di n.8 lampade scialitiche a Led su stativo con ruote mod. mach Led di cui n.2 mod. 300DF e n.6 mod. Mach led 130F alla ditta Ultramed , per l'importo complessivo di €.21.795,20 + Iva.


D E T E R M I N A

Per quanto in premessa esposto:

- 1) **APPROVARE** gli atti di gara della procedura sottosoglia indetta sul MEPA - ID RDO n°1151273 del 17/03/2016 per la fornitura di n.8 lampade scialitiche per le UU.OO. di Dermatologia, Chirurgia e Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Umberto I di Enna.
- 2) **AFFIDARE** alla Ditta Ultramed la sottocitata fornitura:
N. 2 lampade scialitiche a led su stativo con ruote mod. Mach Led 300DF
N. 6 lampade scialitiche a led su stativo con ruote mod. Mach Led 130DF
per UU.OO. di Dermatologia, Chirurgia e Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Umberto I di Enna per l'importo complessivo €. 26.590,50 Iva inclusa.
- 3) **PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito CONSIP – MEPA delle risultanze di gara.
- 4) **AUTORIZZARE** il superiore costo di €. 26.590,50 Iva compresa al conto n. 101020501 a valere sui fondi del PSN. 2010- prog.54- contratto n.723/2016- CIG ZAD1908125.
- 5) **DARE ATTO** che la spesa trova copertura nel corrente bilancio come attestato dal visto contabile apposto dal Direttore del SEFP.
- 6) **DARE MANDATO** al Responsabile di Magazzino di provvedere all'emissione dell' ordine, ricevimento, inventariazione e liquidazione delle spettanze, dietro presentazione di regolare fattura, da parte della ditta individuata per la fornitura in oggetto, previa attestazione di regolarità espressa dal referente esecutore del contratto.
- 7) **DARE MANDATO** al Responsabile Ufficio Tecnico di presiedere alle operazioni di collaudo, unitamente al Tecnico del Servizio di Ingegneria Clinica, al Sanitario interessato e al Tecnico della Ditta.
- 8) **NOMINARE**, ai sensi dell'art.109 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., esecutore del contratto i Responsabili delle UU.OO. di Dermatologia, Chirurgia e Ostetricia e Ginecologia del P.O."Umberto I" di Enna.

9) **DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo per una pronta acquisizione dei beni di che trattasi.

**Il Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato - Economato
Dr. Libera F. Carta**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. F. Carta', written in a cursive style.

Si dichiara che la presente determina è stata trasmessa all'Ufficio Delibere in data _____

L'incaricato _____

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determina, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'albo della ASP di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., dal 30 OTT. 2016 al 13 NOV. 2016

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRIGENTE AMM/VO U.O.C. COORDINAMENTO STAFF
(Dott.ssa Lorenza Garofalo)

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

ESECUTIVITA' DETERMINA

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____
- immediatamente esecutiva dal 26 OTT. 2016

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n° _____ del _____
- Modifica con provvedimento n° _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

**CONTRATTO**

ANNO : 2016 - 723

VALIDO : 06/10/2016 al: 31/12/2016

TIPO : 5 - CONTRATTO DI APPALTO

FORNITORE

20276 - ULTRAMED S.R.L.

VIA MARCELLO ,7

95027 SAN GREGORIO DI CATANIA, CT

Telefono : 095 7211335

FAX : 095 7211711

DATI CONTRATTO

MAGAZZINO :

CDC RIC :

GARA :

DESCRIZIONE : FORNITURA DI N.8 LAMPADE SCIALITICHE LE
UU.OO. DERMATOLOGIA-CHIRURGIA-OSTETRICIA**VALORE CONTRATTO**

IMPORTO 26 590,50

ORDINATO 0,00

RESIDUO 26 590,50

Codice	Descrizione	UM	Quantita	Prezzo	%Sc	%Iva	Importo
56729	LAMPADA SCIALITICA MOBILE	NR	2,00	6 223,0000000	0,00	22	15184,12

Q.tà ordinata: 0,00

Stato : Aperto

CIG: ZAD1908125

FORNITURA DI N.8 LAMPADE SCIALITICHE

Note: LAMPADA SCIALITICA A LED SU STATIVO CON RUOTE MOD. MACH LED 300DF

56729	LAMPADA SCIALITICA MOBILE	NR	6,00	1 558,2000000	0,00	22	11406,02
-------	---------------------------	----	------	---------------	------	----	----------

Q.tà ordinata: 0,00

Stato : Aperto

CIG: ZAD1908125

FORNITURA DI N.8 LAMPADE SCIALITICHE

Note: LAMPADA SCIALITICA A LED SU STATIVO CON RUOTE MOD. MACH LED 130F



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DI DERMATOLOGIA E M.T.S.
IL DIRETTORE F.F.
Dott. GIUSEPPE GRECA



**ALLA DIRETTORE
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DOTT. LIBERA CARTA**

PROT. 09/2015

OGGETTO: Richiesta urgente di acquisto di lampada scialitica.

Con la presente si richiede con urgenza l'acquisto di una lampada scialitica su stativo a 3 o 5 razze, preferibilmente a LED, a proiezione di luce senza ombre, da collocare presso l'ambulatorio di Reparto presso il quale vengono effettuati tutti gli interventi brevi.

Tale necessità si è ancora di più accentuata da quando la lampada attualmente presente, ma posizionata presso altro ambulatorio, ha evidenziato il guasto tecnico di alcune lampadine che, essendo di vecchia tipologia, come comunicato degli addetti alle manutenzioni aziendali, non sono più rinvenibili sul mercato dei pezzi di ricambio.

Confidando in un benevolo e sollecito accoglimento della presente richiesta, considerata la necessità di dare corretta assistenza ai pazienti anche attraverso l'uso di idonei strumenti di ausilio all'atto chirurgico,

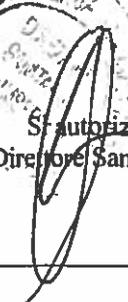
Si coglie l'occasione per porgere

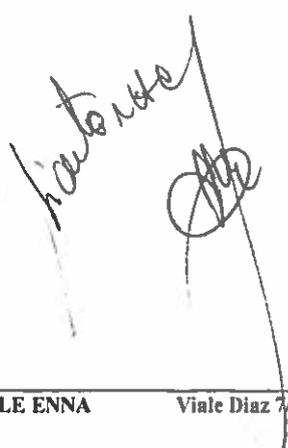
Cordiali saluti


ENNA 05-06-2015

SETTORE PROVVEDITORATO
SERVIZIO APPALTI E FORNITURE

PROTOCOLLO N. 2224
DEL 22 06 15
SOTTOSCRITTO A: Dr. F.F. Greca


Si autorizza
Il Direttore Sanitario del P.O.




Il Direttore F.F.
Dott. Giuseppe Greca
UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
DI DERMATOLOGIA E M.T.S.
IL DIRETTORE F.F.
Dott. GIUSEPPE GRECA


Azienda Sanitaria Provinciale

Presidio Ospedaliero "Umberto I°" - ENNA

U.O. complessa di Dermatologia e Malattie sessualmente trasmesse

Direttore f.f: Dottor Giuseppe Greca

N.2 LAMPADA SCIALITICA A LED SU RUOTE

Lampada scialitica con tecnologia a LED montata su base a cinque razze con altrettante ruote piroettanti di cui almeno 2 dotate di freno.

Intensità luminosa non inferiore a 100.000 lux a 1 metro

Diametro campo non inferiore a 24 cm

Intensità luminosa regolabile da 20% a 100% con comando a sfioramento posto su bordo lampada

Temperatura colore non superiore a 4500° K

Indice resa cromatica non inferiore a 95

Energia irradiata inferiore a 4 mW/mq lx

La lampada deve essere dotata di un sistema che garantisca un'intensità luminosa pari almeno all'80% in caso di usi prolungati


Tasto accensione su corpo lampada

Manipolo sterile ed intercambiabile posizionato centralmente

Durata dei LED non inferiore a 50000 ore

Corpo lampada liscio e privo di spigoli e/o fessure per garantire la massima igiene e facilità di pulizia.

Predisposizione per installazione di una videocamera integrata nel corpo lampada


Dottor Giuseppe Greca

Direttore f.f.

U.O.C. Dermatologia e M.S.T.

ASP "UMBERTO I"
ENNA

DIVISIONE DI CHIRURGIA GENERALE
Direttore Dott. L. Costanzo

AL RESPONSABILE UFFICIO
PROVVEDITORATO
SEDE

Oggetto: richiesta acquisto n°2 scialitiche portatili

Si richiede l'acquisto di n° 2 lampade scialitiche portatili necessarie per svolgere in sicurezza gli interventi di piccola chirurgia presso i 2 Ambulatori Chirurgici della nostra U.O.

Si elencano le specifiche tecniche:

Lampada scialitica con tecnologia a LED montata su base a cinque razze con altrettante ruote piroettanti di cui almeno 2 dotate di freno.

Intensità luminosa non inferiore a 100.000 lux a 1 metro

Diametro campo non inferiore a 24 cm

Intensità luminosa regolabile da 20% a 100% con comando a sfioramento posto su bordo lampada

Temperatura colore non superiore a 4500° K

Indice resa cromatica non inferiore a 95

Energia irradiata inferiore a 4 mW/mq lx

La lampada deve essere dotata di un sistema che garantisca un'intensità luminosa pari almeno all'80% in caso di usi prolungati

Tasto accensione su corpo lampada

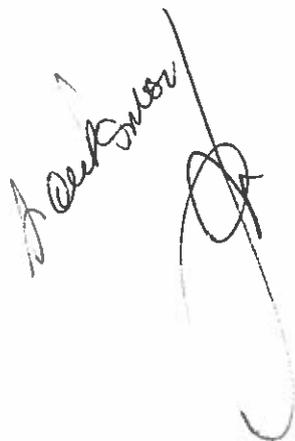
Manipolo sterile ed intercambiabile posizionato centralmente

Durata dei LED non inferiore a 50000 ore


Corpo lampada liscio e privo di spigoli e/o fessure per garantire la massima igiene e facilità di pulizia.

Predisposizione per installazione di una videocamera integrata nel corpo lampada

Enna 16/03/2016



Il Direttore dell'U.O. di Chirurgia Generale
CHIRURGIA GENERALE
dott. L. Costanzo

Distinti Saluti


**Azienda Sanitaria Provinciale
Presidio Ospedaliero Umberto I
E N N A
DIVISIONE di OSTETRICA e GINECOLOGIA
Direttore Dott. G.E. La Ferrera**

Enna li 29/02/016

Prot: 59

Al Direttore Provveditorato
Sede

Oggetto: richiesta lampada scialitica

Si richiedono n°4 lampade scialitiche per la sala parto e gli ambulatori di reparto con le seguenti caratteristiche:

LAMPADA SCIALITICA A LED SU RUOTE

Lampada scialitica con tecnologia a LED montata su base a cinque razze con altrettante ruote piroettanti di cui almeno 2 dotate di freno.

Intensità luminosa non inferiore a 50.000 lux a 1 metro

Diametro campo non inferiore a 22 cm

Intensità luminosa regolabile da 20% a 100% con comando a sfioramento posto su bordo lampada

Temperatura colore non superiore a 4500° K

Indice resa cromatica non inferiore a 90

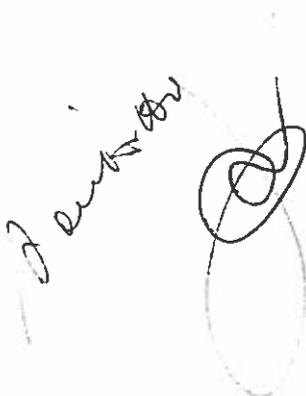
La lampada deve essere dotata di un sistema che garantisca un intensità luminosa pari almeno all'80% in caso di usi prolungati

Tasto accensione su corpo lampada

Manipolo sterile ed intercambiabile

Durata dei LED non inferiore a 50000 ore

Corpo lampada liscio e privo di spigoli e/o fessure per garantire la massima igiene e facilità di pulizia.

Handwritten signature and a circular stamp, possibly a date or reference mark.

Il Direttore
(Dott. G.E. La Ferrera)

Handwritten signature of the Director.



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

A.S.P. DI ENNA
Protocollo Generale
N° Prot. U 2016 - 00068
Del 17/03/2016 D. G.

Tel 0935/520711 – 0935/520345 - Fax 0935/520340 -520345

Servizio: **Provveditorato**

Enna li

Viale Diaz n° 7/9– Cap. 94100 Enna

Protocollo

Oggetto: Richiesta offerta per l'acquisto di lampade scialitiche per diverse UU.OO. dell'Azienda

Spett.le Ditta

Si prega codesta spettabile ditta di far pervenire offerta economica sul ME.PA. – RDO n. - per l'acquisto di lampade scialitiche come da Allegato "A" accluso alla presente lettera d'invito .

La documentazione per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata secondo le modalità di seguito esplicitate.

Prezzo di riferimento € 32.000 Iva esclusa (non superabile)

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Dichiarazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, resa ai sensi della L. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn. iscrizione INPS e INAIL sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato alla documentazione richiesta sul Mepa, come da modello allegato.
- Patto d'integrità anticorruzione.

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Offerta economica senza prezzi con indicazione del bene offerto marca, modello e nome della ditta produttrice;
- scheda tecnica del prodotto offerto + depliant;
- documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- garanzia descrivere – durata minima 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo positivo su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni. Deve intendersi full-risk tutto compreso nonchè tutti gli aggiornamenti rilasciati dalla casa madre;



Regione Siciliana
**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA**

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340 -520345

- disponibilità ad effettuare eventuale demo qualora richiesta dal Sanitario utilizzatore da deffettuare entro 10 giorni dalla richiesta del Sanitario presso l'U.O. di destinazione.

Nel campo offerta economica dovrà essere inserita la sotto citata documentazione :

- offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto , Iva esclusa - CND e Repertorio;
Listino prezzi e percentuale di sconto applicata per eventuali forniture in estensione contrattuale nell'ambito del quinto d'obbligo.
- il prezzo dovrà comprendere: trasporto, consegna, messa in funzione e collaudo;
- l'aggiudicazione avverrà per l'intero lotto in favore della ditta che avrà presentato l'offerta più bassa nel rispetto delle caratteristiche tecniche richieste.

Ai concorrenti potrà essere richiesto di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell' art. 46 del D.Lgs. 163/06.

Adempimenti post aggiudicazione.

- la formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula di contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso.
- la fornitura dovrà essere eseguita sotto esplicito ordine scritto che sarà emesso dai rispettivi Uffici ordinanti;

consegna: Magazzino Generale del P.O. Umberto I di Enna e Piazza Armerina franco trasporto ed ogni altro onere accessorio. I dispositivi dovranno essere corredati dei manuali d'uso, in lingua italiana e dalla documentazione relativa alla conformità alle normative di sicurezza e alla direttiva CEE 93/42 per le apparecchiature elettromedicali. I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti. I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del Magazzino Generale dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine.

Eventuali consegne non effettuate presso il MAGAZZINO saranno considerate come non eseguite. Successivamente alla consegna il bene sarà sottoposto a collaudo alla presenza del sanitario utilizzatore, di un Tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta aggiudicataria.

Il collaudo con esito positivo non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340 -520345

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità.

- **pagamento:** entro 60 (sessanta) giorni a seguito ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- f) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- g) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione.
- i) In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Si avverte che, ai sensi dell' art. 2 della L. R. n.15/2008, sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) la mancata indicazione del numero di Conto Corrente Unico per contratti il cui importo a base d'asta è superiore a 100 mila di euro;
- b) il mancato utilizzo del Conto Corrente Unico per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi, esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile;

Si avverte, altresì, che ai sensi del 2° comma del già citato articolo 2 della L. R. n. 15/2008, si procederà alla risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante della ditta o uno dei dirigenti della stessa impresa aggiudicataria, siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di auto tutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
Servizio Provveditorato/Economato

Tel 0935/520711 - 0935/520345 - Fax 0935/520340 -520345

Per tutto quanto non dichiarato nella presente lettera capitolato, si fa riferimento al regolamento citato, al capitolato generale d'oneri dell'azienda, al capitolato generale d'oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato approvato con D.M. 28.10.1985 ed alle disposizioni di legge in materia.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA - V.LE DIAZ, 7/9 - 94100 - ENNA - P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato
(Dr. Carla F. Libera)

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA
ALLEGATO "A"**

LOTTO UNICO

VOCE 1

N. 2 LAMPADA SCIALITICA A LED SU RUOTE

Lampada scialitica con tecnologia a LED montata su base a cinque razze con altrettante ruote piroettanti di cui almeno 2 dotate di freno.

Intensità luminosa non inferiore a 100.000 lux a 1 metro

Diametro campo non inferiore a 24 cm

Intensità luminosa regolabile da 20% a 100% con comando a sfioramento posto su bordo lampada

Temperatura colore non superiore a 4500° K

Indice resa cromatica non inferiore a 95

Energia irradiata inferiore a 4 mW/mq lx

La lampada deve essere dotata di un sistema che garantisca un'intensità luminosa pari almeno all'80% in caso di usi prolungati

Tasto accensione su corpo lampada

Manipolo sterile ed intercambiabile posizionato centralmente

Durata dei LED non inferiore a 50000 ore

Corpo lampada liscio e privo di spigoli e/o fessure per garantire la massima igiene e facilità di pulizia.

Predisposizione per installazione di una videocamera integrata nel corpo lampada

VOCE 2

N. 6 LAMPADA SCIALITICA A LED SU RUOTE

Lampada scialitica con tecnologia a LED montata su base a cinque razze con altrettante ruote piroettanti di cui almeno 2 dotate di freno.

Intensità luminosa non inferiore a 50.000 lux a 1 metro

Diametro campo non inferiore a 22 cm

Intensità luminosa regolabile da 20% a 100% con comando a sfioramento posto su bordo lampada

Temperatura colore non superiore a 4500° K

Indice resa cromatica non inferiore a 90

La lampada deve essere dotata di un sistema che garantisca un'intensità luminosa pari almeno all'80% in caso di usi prolungati

Tasto accensione su corpo lampada

Manipolo sterile ed intercambiabile

Durata dei LED non inferiore a 50000 ore

Corpo lampada liscio e privo di spigoli e/o fessure per garantire la massima igiene e facilità di pulizia.

IMPORTO DI RIFERIMENTO € 32.000 + IVA

CIG ZAD1908125

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

A - | A + | [contrasto](#) | [ripristina](#)[Home](#) | [L'Azienda](#) | [L'ASP Informa](#) | [Servizi online](#) | [Servizi Sanitari](#) | [Argomenti](#) | [Portale Dipendenti](#)Sei qui: [Home](#) > [Bandi di gara e contratti](#) > [Avvisi procedure indette sul Mepa](#)**Avvisi procedure indette sul Mepa**

Si informa che sono in corso di pubblicazione sul Mepa le seguenti procedure:

RDO N.988067 - SISTEMA ROAD MAP VENOSO

RDO N.1121457- SISTEMA ASPIRA LIQUIDI

RDO N.1143279 -ACQUISTO N.1 VIDEOGASTROSCOPIO HD PER COLONNA PENTAX

RDO N.1149723- MODULI NMT PER I SISTEMI DI ANESTESIA IN DOTAZIONE AL REPARTO

RDO N.1151273 - LAMPADIE SCIALTICHE A LED SU RUOTE

PER INFO 0935/520711 DR.LA PAGLIA

[Aggiungi Allegato](#)**AMMIN. TRASPARENTE**[Disposizioni Generali](#)[Organizzazione](#)[Consulenti e Collaboratori](#)[Personale](#)[Bandi di concorso](#)[Performance](#)[Enti Controllati](#)[Attività e procedimenti](#)[Provvedimenti](#)[Controlli sulle imprese](#)[Bandi di gara e contratti](#)[Sovv. contrib., sussidi, vant.](#)[econ.](#)[Bilanci](#)[Beni Immobili e Gestione del patrimonio](#)[Controlli e rilievi](#)[sull'amministrazione](#)[Servizi erogati](#)[Pagamenti](#)[dell'amministrazione](#)[Opere Pubbliche](#)[Pianificazione e governo del territorio](#)[Informazioni ambientali](#)[Strutture sanitarie private](#)[accred.](#)[Interventi sanitari e di](#)[emergenza](#)[Altri Contenuti](#)**RICERCA**

inserisci testo

inserisci testo

CONTATORE VISITE

Tot. visite contenuti : 1769567



REGIONE SICILIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA

Servizio Provveditorato/Economato

V.le Diaz, 7/9- 94100 –Enna

Tel.0935/520725 – 0935/520711 –fax 0935/520340

Verbale di aggiudicazione per la fornitura di n.6 lampade scialitiche per le UU.OO. di Dermatologia, Chirurgia e Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Umberto I” di Enna – RDO ME.PA n° 1151273.

L'anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di ottobre nei locali dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna siti in Viale Diaz n°7/9,

SONO PRESENTI

Il Dott. Libera F. Carta che assume la Presidenza della gara assistita dai Sigg.ri:

- Dr. Francesca La Paglia - quale segretario verbalizzante;
- Sig. Tiziana Rizza - Testimone;
- Dr. Irene Di Prima - Testimone.
-

SI PREMETTE

Che con note del 16.10.2015 del 29/02/2016 e del 16.03.2016, vistate positivamente dalla Direzione Sanitaria, i Responsabili delle UU.OO. di Dermatologia, Chirurgia e Ostetricia e Ginecologia del P.O.”Umberto I”di Enna hanno formulato la richiesta di acquisto di n.8 lampade scialitiche, in sostituzione di quelli esistenti, guaste e non più riparabili, essendo di vecchia generazione trasmettondone le caratteristiche tecniche;

Che il Servizio Provveditorato – Economato ha indetto sul **ME.PA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)** apposita procedura sottosoglia, tramite l'invio di **una RDO (richiesta di offerta), n°1151273 del 17.03.2016**, invitando tutte le ditte che operano nel territorio Italiano e nel settore di cui è questione, iscritte al **ME.PA**;

Che entro il termine ultimo del 13.04.2016, sono pervenute cinque offerte da parte delle seguenti ditte:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| 1) Grimed s.r.l. | P.I. 02835291200 |
| 2) Maquet Italia | P.I. 03992220966 |
| 3) Odontoiatrika Service Point s.r.l | P.I. 02748570849 |
| 4) Ultramed s.r.l. | P.I. 02732230871 |
| 5) Zovam s.r.l. | P.I. 01466990858 |

Che in data 27 giugno 2016, su espressa indicazione dei Sanitari, è stata richiesta la demo a tutte le Ditte partecipanti da effettuare entro le ore 12,00 dell'11/07/2016;

Che, entro la data fissata, sono state consegnate presso il magazzino generale del P.O. "Umberto I", solamente le lampade offerte dalle Ditte Grimed, Maquet e Ultramed per cui le Ditte Odontoiatrika e Zovam sono state escluse dalla continuazione dalla gara;

Che, relativamente all'esito della demo, sono pervenuti due pareri distinti per ciascuna voce del lotto e, in particolare :

per la voce n.1 riguardante la fornitura di n.2 lampade a led da 100.000 lux tutte le lampade offerte dalle Ditte Grimed, Maquet e Ultramed sono risultate conformi; , mentre per la voce n.2 relativa a n.6 lampade a led da 50.000 lux dal parere dell'Ingegneria Clinica redatto alla presenza del Sanitario e delle Ditte Ultramed e Grimed si evince che l'intensità luminosa delle lampade offerte dalla Ditte Ultramed e Grimed raggiungeva il valore minimo indicato nel capitolato tecnico, mentre la lampada mod. lucea 50 offerta dalla Ditta Maquet raggiungeva un massimo di intensità luminosa pari a 40.000 lux (inferiore al minimo richiesto di 50.000 lux);

Considerato che nella predetta seduta risultava assente la Ditta Maquet Italia la Commissione Tecnica riteneva opportuno riconvocare le ditte per un'ulteriore verifica delle caratteristiche tecniche;

Che nella seduta concordata del 21/9/2016 alla presenza dell'Ingegneria Clinica e delle Ditte Maquet e Ultramed si è proceduto a verificare l'intensità luminosa delle lampade offerte dalla Ditta Ultramed, mentre la lampada offerta dalla Ditta Maquet non risultava funzionante per cui non si è proceduto ad ulteriore verifica confermando la precedente.

CIO PREMESSO

Sulla base di quanto sopra narrato essendo risultate conformi solamente le lampade offerte dalle ditte Ultramed e Grimed si procede all'aggiudicazione delle lampade scialitiche a led su stativo con ruote di cui n.2 mod. Mach Led 300DF e n.6 2 mod. Mach Led 150DF alla Ditta Ultramed s.r.l. che ha offerto il prezzo più basso, nel rispetto delle caratteristiche tecniche del capitolato tecnico, pari a €22.240,00 + Iva.

Si da atto che l'aggiudicazione mentre è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria lo diverrà per l'Amministrazione, dopo che saranno approvati gli atti di gara e il provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo deliberante.

Del che viene chiuso il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE : Dr. Libera F. Carta

IL SEGRETARIO: Dr. Francesca La Paglia

TESTIMONI: Dr. Irene Di Prima

Dr. Tiziana Rizza

The block contains four handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom: the signature of Dr. Libera F. Carta, the signature of Dr. Francesca La Paglia, the signature of Dr. Irene Di Prima, and the signature of Dr. Tiziana Rizza.

**ASP "UMBERTO I"
ENNA**

DIVISIONE DI CHIRURGIA GENERALE
Direttore Dott. L. Costanzo

**AL RESPONSABILE UFFICIO
PROVVEDITORATO
SEDE**

Oggetto: richiesta acquisto n°2 scialitiche portatili

Si richiede l'acquisto di n° 2 lampade scialitiche portatili necessarie per svolgere in sicurezza gli interventi di piccola chirurgia presso i 2 Ambulatori Chirurgici della nostra U.O.

Si elencano le specifiche tecniche:

Lampada scialitica con tecnologia a LED montata su base a cinque razze con altrettante ruote piroettanti di cui almeno 2 dotate di freno.

Intensità luminosa non inferiore a 100.000 lux a 1 metro

Diametro campo non inferiore a 24 cm

Intensità luminosa regolabile da 20% a 100% con comando a sfioramento posto su bordo lampada

Temperatura colore non superiore a 4500° K

Indice resa cromatica non inferiore a 95

Energia irradiata inferiore a 4 mW/mq lx

La lampada deve essere dotata di un sistema che garantisca un'intensità luminosa pari almeno all'80% in caso di usi prolungati

Tasto accensione su corpo lampada

Manipolo sterile ed intercambiabile posizionato centralmente

Durata dei LED non inferiore a 50000 ore

Corpo lampada liscio e privo di spigoli e/o fessure per garantire la massima igiene e facilità di pulizia.

Predisposizione per installazione di una videocamera integrata nel corpo lampada

In riferimento alla richiesta su esposta ed Inviatavi in data 16/03/2016, avendo preso visione delle scialitiche consegnate in demo, possiamo affermare che i modelli che più sono conformi alle nostre esigenze, per intensità luminosa, messa a fuoco, maneggevolezza, sono le scialitiche delle ditte: Luvis modello LM200 e PL2S10 ed Ultramed modello MACH LED 300 DF e Match led 130F

Si conferma, inoltre la necessità, che almeno una delle due scialitiche da assegnare al nostro reparto, sia tra quelle di dimensioni maggiori a resa luminosa superiore ai 100000 Lux



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ENNA
P.O. UMBERTO I°
U.O.C. DI CHIRURGIA GENERALE
Direttore: Dott. Luigi Costanzo
Cod. ENPAM: 800026626K
Ordine Medici: CT6359

Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale Enna

**c.a.: U.O.C. Provveditorato ed Economato
Servizio Appalti e Forniture
D.ssa Francesca La Paglia
p.c: U.O.C. Servizio Tecnico
Direttore Avv. G. Capizzi**

**P. I. Nunzio Bonaventura
Fax.: 0935-981391**

Nr. Prot.: 2016/0166/ASPEN

Enna li, 08/09/2016

**Oggetto: : Verbale di conformità Ditte partecipanti alla RdO 1151273, LOTTO UNICO VOCE
2 N. 6 LAMPADA SCIALITICA A LED SU RUOTE.**

Con riferimento alla valutazione tecnica effettuata sulle lampade scialitiche oggetto della Voce 2 della RdO in oggetto, avendo preso visione dei modelli presentati in demo dalle Ditte Partecipanti (Maquet Italia, Ultramed s.r.l., Grimed s.r.l.) entro i termini di consegna demo richiesti (ore 12:00 del 11/07/2016), in data 26/07/2016 si è rilevato quanto segue:

- Ditta Maquet modello Lucea 50: la lampada scialitica consegnata per la demo raggiunge un massimo di intensità luminosa pari a 40.000 lux, ottenuto regolando al massimo livello tale intensità tramite il comando posto a bordo lampada e posizionando il corpo lampada esattamente ad 1 m di distanza dal campo di intervento.
- Ditta Ultramed s.r.l. modello Mach LED 130 F: la lampada scialitica consegnata per la demo raggiunge un massimo di intensità luminosa pari a 65.000 lux, ottenuto regolando al massimo livello tale intensità tramite il comando posto a bordo lampada (pratico e di elevata ergonomia) e posizionando il corpo lampada esattamente ad 1 m di distanza dal campo di intervento.

- Ditta Grimed s.r.l. modello Luvis S200: la lampada scialitica consegnata per la demo raggiunge un massimo di intensità luminosa pari a 60.000 lux ad 1m, ottenuto regolando al massimo livello tale intensità tramite il comando posto a bordo lampada (pratico e di elevata ergonomia) e posizionando il corpo lampada esattamente ad 1 m di distanza dal campo di intervento.

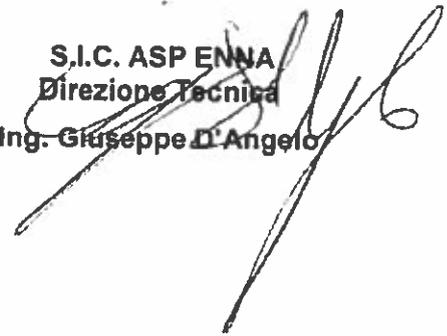
Si fa presente che le suddette verifiche sono state fatte in presenza della Ditta Ultramed s.r.l., delle Ditta Grimed s.r.l. e del Dott. Alaimo.

Non essendo presente la Ditta Maquet Italia, una delle tre partecipanti, si chiede alla S.S.V.V. di riprogrammare la verifica invitando ufficialmente tutti gli interessati, ognuno per le proprie competenze, così da poter stilare un verbale.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito, porgo

Cordiali Saluti

S.I.C. ASP ENNA
Direzione Tecnica
Ing. Giuseppe D'Angelo



Spett.le Azienda Sanitaria Provinciale Enna

**c.a.: U.O.C. Provveditorato ed Economato
Sevizio Appalti e Forniture
D.ssa Francesca La Paglia
p.c: U.O.C. Servizio Tecnico
Direttore Avv. G. Capizzi**

P. I. Nunzio Bonaventura

Fax.: 0935-981391

Nr. Prot.: 2016/0171/ASPEN

Enna li, 21/09/2016

**Oggetto: Verbale di conformità Ditte partecipanti alla RdO 1151273, LOTTO UNICO VOCE 1
N. 2 LAMPADA SCIALITICA A LED SU RUOTE e VOCE 2 N. 6 LAMPADA
SCIALITICA A LED SU RUOTE**

In riferimento a Vostro invito pervenuto tramite email del 19/09/2016 e con riferimento alla valutazione tecnica effettuata sulle lampade scialitiche oggetto della Voce 1 e 2 della RdO in oggetto, avendo preso visione dei modelli presentati in demo dalle Ditte Partecipanti (Maquet Italia, Ultramed s.r.l., Grimed s.r.l.) entro i termini di consegna demo richiesti (ore 12:00 del 11/07/2016), in data 21/09/2016 si è rilevato quanto segue, anche in presenza del Ing. Giuseppe Spadaro per la Ditta Ultramed s.r.l. e il Sig. Alessandro Saitta per la Ditta Maquet Italia:

Ditta Maquet Italia

Modello Lucea 50 (offerto per la Voce 2): la lampada scialitica consegnata per la demo non accendendosi non si è riusciti ad effettuare alcuna verifica.

Modello Lucea 100 (offerto per la Voce 1): la lampada scialitica consegnata per la demo raggiunge un massimo di intensità luminosa pari a 102.100 lux, ottenuto regolando al massimo livello tale intensità tramite il comando posto a bordo lampada e posizionando il corpo lampada esattamente ad 1 m di distanza dal campo di intervento (in allegato foto esplicativa di quanto detto).

Ditta Ultramed s.r.l.

Modello Mach LED 130 F (offerto per la Voce 2): la lampada scialfica consegnata per la demo raggiunge un massimo di intensità luminosa pari a 67.900 lux, ottenuto regolando al massimo livello tale intensità tramite il comando posto a bordo lampada e posizionando il corpo lampada esattamente ad 1 m di distanza dal campo di intervento (in allegato foto esplicativa di quanto detto).

Modello Mach LED 300 DF (offerto per la Voce 1): la lampada scialfica consegnata per la demo raggiunge un massimo di intensità luminosa pari a 137.300 lux, ottenuto regolando al massimo livello tale intensità tramite il comando posto a bordo lampada e posizionando il corpo lampada esattamente ad 1 m di distanza dal campo di intervento.

Ditta Grimed s.r.l.

Non presente

Si fa presente che per le suddette misurazioni si è utilizzato un luxmetro regolarmente tarato e certificato come da documentazione allegata.

Inoltre si comunica che, anche se richiesto, nessuno del personale dei reparti oggetto di installazione delle suddette apparecchiature si è presentato all'incontro.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgo

Cordiali Saluti

Ditta Maquet Italia
Sig. Alessandro Saitta



Ditta Ultramed s.r.l.
Ing. Giuseppe Spadaro



S.I.C. ASP ENNA
Direzione Tecnica
Ing. Giuseppe D'Angelo