



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

DELIBERA N.1159.....
04 AGO 2022
DEL

OGGETTO: Indizione procedura aperta per la fornitura in acquisto di n. 8 ventilatori a pressione positiva automatici con algoritmo AutoSet, n. 4 ventilatori polmonari per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici e n. 4 monitor multiparametrici modulari compatti da destinare alla U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina – Fonte di Finanziamento 109.

U.O. PROPONENTE : U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO – U.O.S. GARE BENI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 483937
DEL 02/08/2022

L'INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA
Assistente Amministrativo

Francesco Nobile
Francesco Nobile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Assistente Amministrativo
Dott.ssa Giandina Digeronimo

Giandina Digeronimo

IL RESPONSABILE U.O.S. GARE BENI
Dott.ssa Francesca La Paglia

Francesca La Paglia

IL DIRETTORE
U.O.C. SERVIZIO PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Concetta Perna

Maria Concetta Perna

IL CAPO DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Ornella Monasteri

S.E.F.P.

Si attesta la copertura finanziaria e la compatibilità con il bilancio di previsione vigente.

come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

Autorizzazione n. _____ del _____ C.E. / C.P. _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Dr. Salvatore Pistone

Salvatore Pistone

IL DIRETTORE DEL S.E.F.P.
D.ssa Ornella Monasteri

Ornella Monasteri

DATA RICEZIONE DELLA PROPOSTA PRESSO UOC STAFF _____

PREMESSO

che, con note del 29/09/2021 con apposto il timbro del protocollo aziendale del 30/09/2021 ed assunte al n. 87878 nella medesima data, il Dirigente Medico Pneumologo, oggi Direttore della U.O.C. Medicina Generale P.O. "Chiello" di Piazza Armerina, ha richiesto l'acquisto, tra gli altri, di n. 8 ventilatori a pressione positiva automatici con algoritmo AutoSet (procedura diagnostica e trattamento dei pazienti affetti da disturbi del sonno), n. 6 ventilatori polmonari per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici (maggiori o uguali a 20 Kg.) e n. 10 Monitor Multiparametrici modulari compatti, da destinare alla suddetta U.O.C.

che, per le vie brevi, il Direttore Generale ha invitato il richiedente Direttore sopracitato ad elaborare un prospetto riassuntivo di tutte le richieste precedentemente presentate;

che, il Direttore Generale ha autorizzato, con sottoscrizione apposta sulla nota riassuntiva prot. 60697 del 14/06/2022, l'acquisto, tra gli altri, di:

- n. 8 ventilatori a pressione positiva automatici con algoritmo AutoSet (procedura diagnostica e trattamento dei pazienti affetti da disturbi del sonno);
- n. 4 ventilatori polmonari per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici (maggiori o uguali a 20 Kg.);
- n. 4 monitor paziente integrato con il ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva e i 4 monitor del sistema di monitoraggio di futura acquisizione, i quali devono possedere le stesse caratteristiche tecniche per essere collegati in rete con il Sistema di monitoraggio paziente avanzato, dotato del protocollo di allarme notifica, denominato Early Warning Scores (EWS);

DATO ATTO

che, l'acquisizione della fornitura in argomento è stata prevista nel piano triennale degli investimenti 2021/2022/2023 e successivamente riportata nel piano triennale degli investimenti 2022/2023/2024, con previsione di acquisizione nell'anno 2022;

che, la somma occorrente per l'acquisizione della fornitura in argomento rientra nella previsione sopra specificata del piano investimenti anno 2022 e nella disponibilità complessiva del conto di pertinenza;

che, per i beni da acquistare, non sono in programmazione gare che saranno esperite dall'Ufficio Speciale della "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi" Regionale, non sono in itinere gare di Bacino ai sensi della Circolare Assessoriale n. 225/2010 e dei verbali del 19/06/2020 e del 16/07/2020 del Comitato di Bacino Sicilia Orientale e non sono attive convenzioni Consip;

che, ai sensi dell'art. 7 comma 2, della Legge 6 luglio 2012 n. 94, "le PP.AA. sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";

che occorre indire idonea procedura di gara, tramite MEPA, per l'individuazione di uno o più operatori economici a cui affidare la fornitura dei beni in argomento;

VERIFICATO

che le caratteristiche dei beni sono state fornite dal Direttore U.O.C. richiedente;

che sul MEPA sono stati individuati i beni di che trattasi;

che, attese le diverse tipologie dei beni richiesti si ritiene opportuno articolare la gara in due lotti come di seguito:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario oltre IVA</i>	<i>Totale oltre IVA</i>
1	Ventilatore a pressione positiva automatico con algoritmo AutoSet	8	€ 750,00	€ 6.000,00
2	sub a) Ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici	4	€ 10.000,00	€ 40.000,00
	sub b) Monitor Paziente integrato con il ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva e i 4 monitor del sistema di monitoraggio di futura acquisizione, i quali devono possedere le stesse caratteristiche tecniche per essere collegati in rete con il Sistema di monitoraggio paziente avanzato, dotato del protocollo di allarme notifica, denominato Early Warning Scores (EWS)	4	€ 8.500,00	€ 34.000,00

Totale complessivo base d'asta € 80.000,00 oltre IVA 22%

RITENUTO

che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, la cui spesa presunta da porre a base d'asta è di € 80.000,00 oltre IVA del 22% pari a € 97.600,00 IVA compresa, ritenuta congrua a seguito di verifica su piattaforma MEPA dei prezzi indicati per la categoria merceologica dei beni in argomento, risulta essere la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire la piena funzionalità della U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" Piazza Armerina) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., invitando tutte le ditte iscritte abilitate per le categorie merceologiche in argomento, e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicarsi, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

che si potrà fare fronte alla spesa presunta di € 80.000,00 oltre IVA 22% (base d'asta) o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, con i fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica", giusta nota dell'Assessorato della Salute, prot. 18989 del 05/04/2022, di ricognizione del Piano Straordinario di Interventi - PO FESR Sicilia 2014/2020-;

che, qualora il suddetto finanziamento non venisse assegnato entro il corrente anno, il costo graverà sul bilancio economico aziendale di competenza e verrà assunto con il successivo provvedimento di aggiudicazione – Progetto 329 – Covid 19.

L'anno duemilaventidue il giorno 04 AGO 2022 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto Presidenziale n. 189/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- ✓ La Legge Regionale 5 /2009 e ss.mm.ii. ;
- ✓ L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A) Estratto nota prot. 87878 del 30/09/2021 relativa alle richieste d'acquisto indicate in premessa, a firma del Direttore U.O.C. Medicina Generale P.O. "Chiello" Piazza Armerina;
- B) Nota riassuntiva prot. 60697 del 16/06/2022, a firma del Direttore U.O.C. Medicina Generale P.O. "Chiello" Piazza Armerina, con autorizzazione apposta dal Direttore Generale;
- C) Lettera d'invito/Capitolato tecnico;
- D) Modello Autodichiarazione ex DPR 445/2000 (mod.B);
- E) Patto d'integrità anticorruzione;
- F) Modello Offerta economica dettagliata;
- G) Modello Tracciabilità dei flussi finanziari.

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI INDIRE** procedura aperta, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire la piena funzionalità della U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" Piazza Armerina), invitando tutte le ditte iscritte e abilitate per la relativa categoria merceologica, in conformità del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicare, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida, per la fornitura dei beni descritti nella lettera d'invito/capitolato, da assegnare alla U.O.C. richiedente, come indicato in premessa e di seguito elencati:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario oltre IVA</i>	<i>Totale oltre IVA</i>
1	Ventilatore a pressione positiva automatico con algoritmo AutoSet	8	€ 750,00	€ 6.000,00
2	sub a) Ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici	4	€ 10.000,00	€ 40.000,00
	sub b) Monitor paziente integrato con il ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva e i 4 monitor del sistema di monitoraggio di futura acquisizione, i quali devono possedere le stesse caratteristiche	4	€ 8.500,00	€ 34.000,00

	tecniche per essere collegati in rete con il Sistema di monitoraggio paziente avanzato, dotato del protocollo di allarme notifica, denominato Early Warning Scores (EWS)			
--	--	--	--	--

Totale complessivo base d'asta € 80.000,00 oltre IVA 22%

2. **DI APPROVARE** la lettera d'invito/capitolato tecnico e i relativi allegati.
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione dell'avviso di gara sul sito Internet Aziendale.
4. **DI DARE ATTO** che la spesa presunta di **€ 80.000,00 oltre IVA 22%** (base d'asta) pari a **€ 97.600,00 IVA compresa** o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, graverà sul **conto patrimoniale n. 101020501 "Attrezzature sanitarie e scientifiche"**, a valere sui fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1,6,1, "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" - Fonte di Finanziamento 109.
5. **DI DARE ATTO** che, qualora il suddetto finanziamento non venisse assegnato entro il corrente anno, il costo graverà sul bilancio economico aziendale di competenza e verrà assunto con il successivo provvedimento di aggiudicazione – Progetto 329 – Covid 19
6. **DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo**, stante l'urgenza di procedere in tempi brevi al necessario acquisto, al fine di evitare conseguenze negative sulle attività della Struttura richiedente.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Sabrina Cilia

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Emanuele Cassarà

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Iudica

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Luisa Franchida

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, su conforme relazione dell'addetto, è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio informatico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n° 30/93 s.m.i., e dell'art. 32 della L. n. 69 del 18/06/2009

dal 07 AGO 2022

al 21 AGO 2022

L'incaricato

PER DELEGA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL Dirigente U.O.C. COORD. STAFF

Notificata al Collegio Sindacale il con nota prot. n°

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

dell'Assessorato Regionale Sanità ex L.R. n° 5/09 trasmessa in data _____ prot. n° _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Sanità:

- ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n° _____ del _____
- ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n° _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n° 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L.R. n° 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n° 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

- immediatamente esecutiva dal 04 AGO 2022

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n°. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n°. _____ del _____

Enna li,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Bem

Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

E N N A



Cod. fisc./P.IVA 01151150867

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

Servizio di Pneumologia

Al Sig. Direttore Generale
dell'ASP Enna

Oggetto: Programma investimenti centro di pneumologia 2021

Si richiedono 8 Ventilatori a pressione positiva automatico con algoritmo AutoSet con le seguenti caratteristiche tecniche:

Ventilatore a pressione positiva automatico con algoritmo AutoSet™ per la titolazione e per il trattamento di pazienti affetti da Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS).

Dotato di tecnologia di trasmissione-ricezione dati in modalità wireless (senza fili) su rete GSM.

Algoritmo AutoSet™ potenziato, validato clinicamente per la risposta in automatico a Limitazione di Flusso,

Russamento ed Apnea Ostruttiva, con distinzione dei tipi di Apnee.

Tecnologia "F.O.T."™ (Forced Oscillation Technology) in grado di distinguere le Apnee Centrali dalle Apnee

Ostruttive con miglioramento delle risposte pressorie e trattamento adeguato dei singoli eventi.

Calcolo automatico di perdite intenzionali su fori di esalazione maschera con selezione dell'interfaccia dal menù di impostazioni.

Pressioni operative da 4 a 20 cmH₂O

Caratteristiche tecniche:

- Modalità di funzionamento: Auto CPAP - CPAP
- Selezione delle interfacce: Tipo di maschera
- Tipologia di ventilazione: Non Invasiva
- Pressioni erogate: da 4 a 20 cmH₂O
- Algoritmo AutoSet per il trattamento degli eventi ostruttivi: limitazione di flusso - russamento - apnea
- Regolazione manuale tempo di rampa (CPAP) per il raggiungimento della pressione terapeutica



- Regolazione manuale tempo di stabilizzazione (AutoSet) per il raggiungimento della pressione terapeutica
- Regolazione automatica tempo di stabilizzazione (AutoSet) con rilevamento dell'addormentamento del paziente
- Compensazione automatica dell'altitudine
- Display LCD a colori per la visualizzazione diretta dei seguenti parametri:
 - Impostazioni
 - Modalità in uso
 - Pressioni erogate
 - Perdite in Litri/Minuto
 - Indice di Apnea/Ipopnea
 - Indice di Apnea
 - Dati di efficacia e dati di utilizzo
 - SpO2 e Frequenza Cardiaca (con modulo opzionale)
 - Menù Paziente (base e avanzato)
 - Utilizzo del dispositivo (giornaliero-mensile-trimestrale-semestrale-annuale) con contatore e indici di compliance
 - Opzioni
- Programmazione di Promemoria per il Paziente anche ad intervalli ripetuti, da 1 a 24 mesi (sostituzione maschera – sostituzione filtro – chiamata medico – inserimento scheda memoria – chiamata tecnico – promemoria personalizzabile).
- Memoria interna di 365 sessioni che possono essere visualizzate sul dispositivo, ResScan™ e in wireless mediante AirView™ e 30 sessioni di dati dettagliati ad alta risoluzione visualizzabili su computer attraverso il software dedicato ResScan™, con gestione cartella clinica del paziente, follow up, programmazione visite di controllo, ecc.
- Funzione Smart Start™ sospende/riprende la terapia quando viene rilevata la disconnessione/connesione della maschera dal viso del paziente
- Funzione A.E. (Aiuto Espiratorio) provvede ad abbassare la pressione erogata in fase espiratoria (-1 / -2 / -3 cmH2O) per migliorare il comfort e la compliance del paziente
- Funzione di compensazione automatica delle perdite con risposta di compensazione fino ad 1 litro al secondo di perdite non intenzionali.
- Sistema di umidificazione opzionale integrato e riscaldato HumidAir™ con Climate Control™ per la regolazione (automatica o manuale) della temperatura e del livello di umidificazione. Circuito paziente opzionale Climate LineAir™, riscaldato e dotato di sensori di temperatura per l'erogazione in automatico dell'85% di umidità relativa. Sistema di protezione anti-condensa, anche ad altissimi livelli di umidificazione.
- Alimentazione elettrica 110/220 Volt con possibilità (opzionale) di utilizzo con alimentazione a 12/24 Volt
- Batteria esterna opzionale ResMed PowerStation II™.
- Apparecchiatura conforme alle normative Internazionali IEC 601.1, classe II tipo BF, realizzato in conformità con la Direttiva Comunitaria 93/42/EEC (CE).
- Livello di emissioni sonore 27dBA, livello di pressione a 1 metro 13dBA

N...

- Dimensioni in millimetri: Altezza 116 - Larghezza 255 - Profondità 150 (con HumidAir)
- Peso: Kg. 1,115
- Condizioni ambientali: temperatura di esercizio tra +5 e +40°C - Umidità di esercizio 15-95% non condensante - Temperatura di stoccaggio e trasporto tra -20 e +60° C - Umidità di stoccaggio e trasporto fino al 95% non condensante
- Fornito di borsa per il trasporto per apparecchiatura ed accessori.

Enna, 29.09.2021

Dott. Giuseppe Iraci
Dirigente Medico Pneumologo

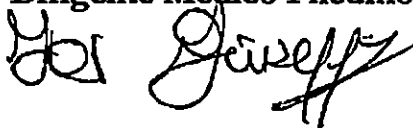



Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

Cod. fisc./P.IVA 01151150857

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

Servizio di Pneumologia

REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale
30 SET 2021
ENNA

Al Sig. Direttore Generale
dell'ASP Enna

Oggetto: Programma investimenti centro di pneumologia 2021

Si richiedono 10 Monitor Paziente integrato con il ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva con le seguenti caratteristiche tecniche:

Prodotto	Peso max	L x A x P
Monitor MX400	6 kg	277x288x186 mm
M3001A/M3001AL Modulo Multiparametrico (MMS)	0,6 kg	189 x 98 x 57 mm
M3002A IntelliVue X2 (MMS)	1,2 kg	189 x 99 x 89 mm
M3012A Modulo di Estensione per Emodinamica	0,6 kg	200 x 98 x 89 mm
M3014A Modulo di Estensione per Capnografia	0,6 kg	200 x 98 x 89 mm
M3015A/B Modulo di Estensione con CO ₂ Microstream	0,6 kg	202 x 98 x 89 mm
865244 Telecomando	0,4 kg	53 x 172 x 40 mm
866406 Dispositivo remoto di allarme	0,4 kg	261 x 32 x 81 mm

Ben

13m

Specifica	Condizione	Gamma
Gamma di temperatura	In funzione	Dal 0 a 40 °C
Umidità	In funzione	Dal 15 al 95% di umidità relativa (UR) senza condensa
Altitudine	A magazzino	Dal 5 al 95% (UR)
	In funzione	Da 500 a 3000 m
	A magazzino	Da 500 a 4600 m

Telecomando

Specifica	Condizione	Gamma
Gamma di temperatura	In funzione	Dal 0 a 40 °C
Umidità	A magazzino	Da 0 a 35 °C
	In funzione	Dal 15 al 95% di umidità relativa (UR) senza condensa
Altitudine	A magazzino	Dal 5 al 95% (UR)
	In funzione	Da 500 a 3000 m
	A magazzino	Da 500 a 4600 m
Grado di protezione		IP21

Smart-Hopping:
oppure con interfaccia
montato sul retro
batteria, con M3002A
Durante la ricarica della

Monitor

Specifiche operative del monitor

Alimentazione elettrica	Potenza assorbita	Valore medio: < 70 W
	Tensione di rete	100-240 V
	Corrente	1,2-0,5 A
	Frequenza	50/60 Hz
Display WVGA da 9"	LCD a colori a matrice attiva da 230 mm (TFT)	
	Risoluzione	800 x 480
	Schermo utile	196,8 x 118,1 mm
	Pixel pitch	0,246 x 0,246
Indicatori	Allarmi disattivati	LED rosso (simbolo di allarme barrato)
	Allarmi	LED rosso/giallo/azzurro
	Accensione/Attesa/Errore	LED verde/rosso integrato nell'interruttore di accensione
	Alimentazione esterna	LED verde
	Batteria	LED rosso/giallo/verde

- Segnali acustici**
- Segnale acustico per input utente
 - Tono di prompt
 - Tono QRS o tono di modulazione SpO₂
 - Quattro diversi segnali acustici di allarme
 - Tono remoto per allarmi da altri letti in rete
 - Tono per scadenza-timer

Velocità delle forme d'onda sul display

Per le onde standard: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s con precisione pari a ±5% (garantita solo per i display integrati)

Trend

Risoluzione: 50 valori numerici con:

- 4 h a 12 sec
- 24 h a 1 min
- 48 h a 5 min

Nm

Forme d'onda di trend ad alta risoluzione	Misurazioni disponibili	FC, SpO ₂ , Resp, Polso, Perf, CO ₂ , ABP, PAP, CVP, ICP, CPP, CCO, Agenti anestetici, O ₂ in
	Risoluzione	I campioni di misurazione vengono acquisiti con una risoluzione di 4 campioni al secondo
	Velocità di aggiornamento	Forme d'onda tracciate a una velocità di 3 cm/minuto
Eventi	Informazioni	Condizione e ora di attivazione, classificazione dell'evento e relativa visualizzazione dettagliata dei dati dell'episodio
	Dati dell'episodio	Configurabili come segue: <ul style="list-style-type: none"> • 4 minuti di trend ad alta risoluzione oppure • 20 minuti di trend di valori numerici a una risoluzione di 12 secondi oppure • 15 secondi con 4 forme d'onda a 125 campioni/secondo (istantanea) con inclusione di tutti i valori numerici, gli allarmi e i messaggi di INOP correnti
	Capacità (max)	25 o 50 eventi per 8 o 24 ore

N...

Segnale di allarme	Ritardo di sistema	Inferiore a 4 secondi
	Durata della pausa	1, 2, 3 minuti o illimitata, a seconda della configurazione
	Pausa allarme prolungata	5 o 10 minuti
Riesame degli allarmi	Informazioni	Tutti gli allarmi/INOP, attivazione/disattivazione degli allarmi principali, tacitazione degli allarmi con indicazione dell'ora
	Capacità	300 voci
Orologio in tempo reale	Gamma	Dal 1° gennaio 1997, ore 00:00 al 31 dicembre 2080, ore 23:59
	Precisione	Maggiore di 4 secondi al giorno
	Durata	Infinita con alimentazione CA, almeno 48 ore negli altri casi (tipica: > 72 ore)
Memoria-buffer	Durata	Con alimentazione CA: infinita Senza alimentazione: almeno 8 ore
	Contenuto	Impostazioni attive, trend, dati paziente, referti in tempo reale, eventi, riesame allarmi

Rete	Standard	10BASE-T e 100Base-TX (IEEE 802.3)
		autonegoziazione, full e half-duplex
	Connettore	RJ45 (8 pin)
	Isolamento	Isolamento di base (tensione di riferimento: 250 V; tensione di prova: 1500 V)

Interfaccia	Tipo	Adattatore WMTS interno
Smart		
Hopping	Tecnologia	Compatibile con Philips Cellular Telemetry System (CTS), infrastruttura cellulare
1,4 GHz (solo		
Stat) Uniti)		
	Banda di frequenza	WMTS: 1395-1400 MHz e 1427-1432 MHz
	Tecnica di modulazione	GFSK
	Potenza irradiata efficace	ERP max 10 dBm (9 mW)
Interfaccia	Tipo	Adattatore ISM interno
Smart		
Hopping	Tecnologia	Compatibile con Philips Cellular Telemetry System (CTS), infrastruttura cellulare
2,4 GHz		
	Banda di frequenza	Banda ISM da 2,400-2,483 GHz
	Tecnica di modulazione	GFSK
	Potenza irradiata efficace	ERP max 18 dBm (64 mW)

Ben

Interfaccia wireless	Tipo	Adattatore wireless interno
802.11	Tecnologia	IEEE 802.11a/b/g/n
(adattatore per reti wireless)	Banda di frequenza	Banda 2,4 e 5 GHz
		USA
		2,400–2,483 GHz
		5,15–5,35 GHz
		5,72–5,825 GHz
	Europa	2,400–2,483 GHz
		5,15–5,35 GHz
		5,470–5,725 GHz
	Giappone	2,400–2,483 GHz
		5,15–5,25 GHz
	5,25–5,35 GHz	
	5,470–5,725 GHz	
	Cina	2,400–2,483 GHz
		5,725–5,85 GHz
	Tecnica di modulazione	<ul style="list-style-type: none"> • DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK) • OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
	802.11b/g/n	
	Tecnica di modulazione	OFDM (BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
	802.11a/n	
	Larghezza di banda	20/40 MHz (nominali)
	Potenza irradiata efficace (ERP) max	<ul style="list-style-type: none"> • 2,400–2,483 GHz: 16 dBm (40 mW) • 5,150–5,725 GHz: 15 dBm (32 mW) • 5,745–5,825 GHz: 13 dBm (20 mW)
Interfaccia radio a corto raggio	Tipo	Interfaccia SRR interna
	Tecnologia	IEEE 802.15.4
	Banda di frequenza	ISM a 2,4 GHz (2,400–2,483 GHz)
	Tecnica di modulazione	DSSS (O-QPSK)
	Potenza irradiata efficace	Max 0 dBm (1 mW)

Bum

Interfaccia USB	Standard	USB 2.0 full speed
	Connettore	Presse USB serie "Standard A"
	Alimentazione	Porta bassa tensione 4,4 V min.; carico massimo per la somma di tutte le porte 500 mA
Doppia interfaccia MIB/RS232^a	Isolamento	Nessuno
	Standard	IEEE 11073-30200
	Connettore	RJ45 (otto pin)
	Modo	BCC (RxD/TxD incrociato) o DCC (RxD/TxD non incrociato) controllabile dal software
	Alimentazione	5 V \pm 5%, 100 mA (max)
Interfaccia del sistema di chiamata infermiere flessibile^a	Isolamento	Isolamento di base (tensione di riferimento: 250 V, tensione di prova: 1500 V)
	Connettore	MDR (Mini D-Ribbon) a 20 pin, contatti attivi aperti e chiusi.
	Contatto	\leq 100 mA, \leq 24 V CC
	Isolamento	Isolamento di base (tensione di riferimento: 250 V; tensione di prova: 1500 V)
IntelliBridge	Ritardo	< (latenza configurata + 0,5 secondi)
	Connettore	Jack modulare 8P8C
	Connettività	RS232/LAN
	Alimentazione	5 V 5% a 0-100 mA ^b
IntelliBridge	Isolamento	Isolamento doppio (tensione di riferimento: 250 V; tensione di prova: 4000 V)

B...

Interfaccia di sistema avanzata^d

RS232/5 V

Standard

IEEE 11073 30200

Connettore

RJ45 (otto pin)

Modo

BCC

(RxD/TxD incrociato)

Alimentazione



5 V \pm 5%, 100 mA (max)

Costo dei monitor: cadauno euro 8.500,00

29/09/2021

Dott. Giuseppe Iraci

Dirigente Medico Pneumologo





Regione Siciliana

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ENNA

Cod. fisc./P.IVA 01151150867

WEB: <http://www.asp.enna.it/>

Servizio di Pneumologia



Al Sig. Direttore Generale
dell'ASP Enna

Oggetto: Programma investimenti centro di pneumologia 2021

Si richiedono 6 Ventilatori polmonari per la ventilazione non invasiva con le seguenti caratteristiche tecniche:

Specifiche tecniche

1. Tipi di paziente

Adulti

Pediatrici (≥ 20 kg)

2. Modalità/terapia

Standard

HFT (ossigenoterapia ad alti flussi)

CPAP (pressione positiva continua delle vie aeree)

S/T (spontanea/temporizzata)

PCV (ventilazione a pressione controllata)

AVAPS (volume medio garantito in pressione di supporto).

Opzionale

PPV (ventilazione a pressione proporzionale)

Auto-Trak Plus

3. Impostazioni

Impostazioni Intervallo

Flusso (solo HFT)

Da 10 a 80 l/min

C-Flex

OFF, da 1 a 3

CPAP

Da 4 a 25 cmH₂O

EPAP	Da 4 a 25 cmH2O
IPAP	Da 4 a 40 cmH2O
T insp (tempo inspiratorio)	Da 0,30 a 3,00 s
P max (pressione IPAP max AVAPS)	Da 6 a 40 cmH2O
P min (pressione IPAP min AVAPS)	Da 5 a 30 cmH2O
O2 (percentuale di ossigeno)	Da 21 a 100%
Tempo di rampa	OFF, da 5 a 45 min
Freq. (frequenza respiratoria)	Da 4 a 60 bpm
Salita (tempo di salita)	Da 1 a 5
Trigger e ciclaggio	Adattamento automatico (Auto-Trak)
Volume corrente target AVAPS	Da 200 a 2000 ml BTPS
Max E	Da 0 a 100 cmH2O/I
Max R	Da 0 a 50 cmH2O/l/s
% PPV	Da 0 a 100%
P max (limite pressione PPV massimo)	Da 5 a 40 cmH2O
V max (limite volume PPV massimo)	Da 200 a 3500 ml

4. Modalità/terapia e impostazioni

	CPAP	S/T	PCV	AVAPS	PPV	HFT
F req.		•	•	•	•	
T insp		•	•	•	•	
CPAP	•					
EPAP		•	•	•	•	
IPAP		•	•		•	
Salita		•	•	•	•	
P min				•		
P max				•	•	
V max					•	
Max E					•	
Max R					•	
% PPV					•	
O2	•	•	•	•	•	•
VT (volume corrente)				•		
C-Flex	•					
Tempo di rampa	•	•	•			
Flusso						•

5. Parametri monitorati

Finestra dati paziente	
Fase respiro/indicatore trigger	Spont., Temp., Espiraz.
PIP	Da 0 a 50 cmH2O
Perd. paz./Perd. tot.	Da 0 a 200 l/min BTPS
Trig. paz.	Da 0 a 100%

Nun

Frequenza respiratoria	Da 0 a 90 BPM
Ti/Ttot	Da 0 a 91%
Volume minuto	Da 0 a 99,0 l/min BTPS
Volume corrente	Da 0 a 3500 ml BTPS
Finestra delle forme d'onda	
Forma d'onda della pressione	Da 0 a 50 cmH2O
Forma d'onda del flusso	Da -240 a 240 l/min BTPS
Forma d'onda del volume	Da 0 a 3500 ml BTPS

6. Allarmi

Allarme Intervallo regolabile

Freq. Alta (Allarme alta frequenza)	Da 5 a 90 BPM
Freq. Bassa (Allarme bassa frequenza)	Da 1 a 89 BPM
VT Alto (Allarme volume corrente alto)	Da 200 a 3500 ml
VT Basso (Allarme volume corrente basso)	OFF, da 5 a 1500 ml
PIA (Allarme pressione inspiratoria alta)	Da 5 a 50 cmH2O
PI Bassa (Allarme pressione inspiratoria bassa)	OFF, da 1 a 40 cmH2O
VE Basso (Allarme ventilazione minuto bassa)	OFF, da 0,1 a 99 l/min
tPI Bassa (Ritardo di allarme pressione inspiratoria bassa)	Da 5 a 60 secondi

7. Altre impostazioni

Livello acustico degli allarmi	Da 1 a 10 (scala relativa)
Luminosità	Da 1 a 5 (scala relativa)
Selezione porta espiratoria	<ul style="list-style-type: none"> • DEP (porta espiratoria monouso) • Whisper Swivel • PEV (valvola espiratoria di plateau) • Altro • Nessuna (nessuna porta espiratoria nel circuito)
Selezione interfaccia	ET/Trach, 1, 2, 3, Altra
Blocco schermo	Spento, Acceso
Auto-Trak Plus	Opzionale
Trigger	Normale, da 1 a 7
Ciclo E	-2, -1, Normale, da 1 a 6

8. Specifiche ambientali

Temperatura	
Di esercizio	Da +5 a +40 °C
A magazzino	Da -20 a +50 °C
Umidità relativa	
Di esercizio	Da 15 a 95%
(senza condensa)	
A magazzino	Da 10 a 95%

AS

(senza condensa)

Pressione barometrica
In funzione Da 79,9 a 101,1 kPa
(da 600 a 765 mmHg) Altitudine
In funzione Da 600 a 765 mmHg
(da -61 a 1951 m circa
rispetto al livello del mare)

9. Comunicazione

Philips IntelliBridge EC10
Philips IntelliBridge EC40/80
Philips VueLink Open Interface
Sistema di diagnostica a distanza Respi-Link
Sistema di gestione Bernoulli®
Driver di interfaccia del dispositivo Capsule DataCaptor™
GE Healthcare (Centricity™ Critical Care)
Cerner CareAware® iBus™
Altri sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati paziente
RS232 digitale e analogica

10. Specifiche elettriche

Alimentazione esterna
Tensione CA Da 100 a 240 VCA
Frequenza CA 50/60 Hz
Alimentazione CA 300 VA
Batteria (opzionale)
Tensione nominale 14,4 V
Capacità 11,0 Ah
Tipo di batteria Ioni di litio
Autonomia 6 ore in condizioni normali

11. Specifiche fisiche

Peso 11,7 kg con batteria opzionale
10,6 kg senza batteria opzionale

Dimensioni
Altezza: 33,7 cm
Larghezza: 39,4 cm
Profondità: 42,9 cm

Costo presunto circa 10.000 euro + iva cadauno

29/09/2021

Dott. Giuseppe Iraci
Dirigente Medico Pneumologo





Prot. n. _____ del _____

2 Plocato
WPE

Cod. fisc./P.IVA 01151150867
Tel. 0935-520.111
Fax 0935-520.851

DIREZIONE U.O.C. MEDICINA GENERALE
P.O. "CHIELLO" PIAZZA ARMERINA

WEB: <http://www.aspenna.it/>

Al Direttore Generale

SEDE

Oggetto: Richiesta riassuntiva di precedenti richieste assunte al Prot. Gen. con n. 87878 del 30/09/2021.

Con riferimento alle distinte richieste di acquisto di Apparecchiature/Attrezzature per la Pneumologia/Medicina Interna, datate 29/09/2021, indirizzate alla S.V., assunte in ingresso al Protocollo Generale dell'A.S.P., al n. 87878 del 30/09/2021, il sottoscritto, nella qualità di Direttore della U.O.C. Medicina Generale P.O. "Chiello" Piazza Armerina, con la presente riassume le suddette richieste, già complete di caratteristiche tecniche e di una stima di costi, secondo il seguente ordine di priorità, integrando alcune precisazioni e ulteriori esigenze rilevate presso la suddetta U.O.C. per garantirne la piena funzionalità:



N.	DESCRIZIONE	COSTO PRESUNTO oltre IVA	AUTORIZZATA NEL PIANO INVESTIMENTI 2021	NUOVA RICHIESTA	Fonte finanz
1.	Stazione di lettura e acquisizione di test spirometrici (Sistema computerizzato da collegare allo Spirometro Encore 22D già in dotazione al reparto)	€ 18.500,00	SI alla voce "aggiornamento software e Hardware spirometro in dotazione"	-	PO FE 2014/2
2.	Cabina Pletismografica computerizzata	€ 25.000,00	-	SI	PO FE 2014/2
3.	8 Ventilatori a pressione positiva automatici con algoritmo AutoSet (procedura diagnostica e trattamento dei pazienti affetti da disturbi del sonno)	€ 6.000,00	SI alla voce "4 AutoCPAP titolazione pz OSAS controllo da remoto" (€ 6.000,00)	-	PO FESI 2014/20
4.	4 Poligrafi per la diagnosi dei disturbi del sonno	€ 28.000,00	SI alla voce "4 Poligrafi per la diagnosi disturbo sonno"	-	bilan
5.	4 Ventilatori polmonari per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici (maggiori o uguali 20 Kg.)	€ 40.000,00	SI alla voce "6 Ventilatori polmonari" (€ 200.000,00)	-	PO FE 2014/2
6.	2 Emogasanalizzatore	Fornitura in service	-	SI	bilan
7.	2 Elettrocardiografi	€	-	SI	PO FI 2014/2
8.	1 Ecocardiografo	€	-	SI	PO FI 2014/2
9.	4 Umidificatori per ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva	€ 4.000,00	-	SI	bilan
10.	4 Monitor Paziente integrato con il ventilatore	e. 34.000,00	-	-	PO F

Plocato

polmonare per la ventilazione non invasiva e i 4 monitor del sistema di monitoraggio devono possedere le stesse caratteristiche tecniche per essere collegati in rete con il Sistema di monitoraggio paziente avanzato, dotato del protocollo di allarme notifica, denominato Early Warning Scores (EWS).			SI	2014/20
---	--	--	----	---------

Si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
U.O.C. Medicina Generale
P.O. "Chiello" Piazza Armerina
Dr. Giuseppe Iraci

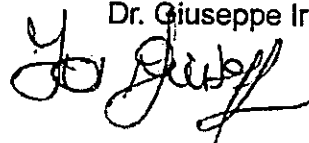



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

U.O.C. Servizio Provveditorato

Spett.li ditte

Direttore

U.O.C. Servizio Provveditorato:

Dott.ssa Maria Concetta Perna
 e-mail: direttore.provveditorato@asp.enna.it
provveditorato@pec.asp.enna.it

Responsabile U.O.S. Gare Beni:

Dott.ssa Francesca La Paglia
 tel. 0935/520711
 e – mail: francesca.lapaglia@asp.enna.it

Responsabile del Procedimento:

Dott.ssa Claudia Digeronimo
 tel. 0935/520131
 e – mail: claudia.digeronimo@asp.enna.it

L'Incaricato dell'Istruttoria:

Francesco Nobile
 tel. 0935/520344
 e – mail: francesco.nobile@asp.enna.it

Oggetto: Lettera di invito per la fornitura in acquisto di n. 8 ventilatori a pressione positiva automatici con algoritmo AutoSet, n. 4 ventilatori polmonari per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici e n. 4 monitor multiparametrici modulari compatti da destinare alla U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina

Si invitano codeste spettabili ditte a far pervenire offerta economica sul ME.PA per le seguenti forniture:

LOTTO 1:

- N. 8 ventilatori a pressione positiva automatici con algoritmo AutoSet da destinare alla U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

Importo presunto a base d'asta LOTTO 1: €. 6.000,00 oltre IVA del 22%

CIG:

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
 Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 2:

sub. a)

- **N. 4 ventilatori polmonari per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici (maggiori o uguali 20 kg.)** da destinare alla U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

Importo presunto a base d'asta €. 40.000,00 oltre IVA del 22%

sub. b)

- **N. 4 Monitor paziente integrato con il ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva e i 4 monitor del sistema di monitoraggio di futura acquisizione, devono possedere le stesse caratteristiche tecniche per essere collegati in rete con il Sistema di monitoraggio paziente avanzato, dotato del protocollo di allarme notifica, denominato Early Warning Scores (EWS)** da destinare alla U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.

Importo presunto a base d'asta €. 34.000,00 oltre IVA del 22%

Importo presunto a base d'asta LOTTO 2: €. 74.000,00 oltre IVA del 22%

CIG:

Si precisa che le specifiche tecniche indicate nell'allegato A, accluso alla presente, si devono intendere espresse ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., cioè seguendo pedissequamente il seguente assunto, elaborato dalla dottrina e fatto proprio da questa Stazione appaltante:

L'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto consente alla stazione appaltante di disporre di un parametro di riferimento sulla cui base poter procedere alla valutazione delle offerte ricevute e, successivamente, verificare la corrispondenza tra quanto richiesto e la prestazione ricevuta dall'aggiudicatario.

Diversamente, sotto il secondo profilo, l'individuazione delle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto permette agli operatori economici di poter circoscrivere la propria offerta verificando, eventualmente, la legittimità dell'aggiudicazione.

La formulazione delle specifiche tecniche deve avvenire nel rispetto delle regole della corretta concorrenza tra gli operatori economici del mercato e, di conseguenza, nel rispetto dei principi in cui la concorrenza è tradizionalmente declinata, quali il principio di non discriminazione, il principio di parità di trattamento e il principio di massima partecipazione.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

La descrizione delle caratteristiche tecniche del bene oggetto dell'appalto, dunque, non esclude dalla valutazione quelle offerte il cui contenuto sia comunque strutturalmente e funzionalmente corrispondente a quanto richiesto con la presente richiesta d'offerta e deve intendersi coerente con la c.d. clausola di equivalenza, ovvero sia con l'esigenza che sia prevista la possibilità, per i concorrenti, di offrire beni e servizi con caratteristiche equivalenti rispetto a quelle richieste.

Conseguentemente la stazione appaltante valuterà se quanto offerto dai partecipanti alla gara possa ritenersi equivalente alle caratteristiche della prestazione o del bene indicate nelle specifiche tecniche.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, infatti, la clausola di equivalenza si ritiene applicabile "qualora siano inserite nella lex specialis di gara specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o una provenienza determinata, o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o a un brevetto)", al fine di favorire la presentazione di una proposta "che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti".

Il principio di equivalenza, pertanto, è vincolante per l'amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari predispongano una descrizione sì particolareggiata e puntuale al punto che "avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".


L'onere della prova dell'equivalenza grava sull'offerente, residuando invero in capo alla stazione appaltante la valutazione circa la conformità del contenuto dell'offerta rispetto all'oggetto dell'appalto così come descritto nelle specifiche tecniche, senza che possa ravvisarsi in capo alla stessa un onere di attività di indagine circa l'asserita equivalenza.

Contemporaneamente con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza si precisa che l'equivalenza non può essere meramente affermata dall'impresa partecipante alla gara, bensì "va dimostrata in modo rigoroso con una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto, e comunque deve formare oggetto di apposita dichiarazione allegata all'offerta", con la conseguenza che "sin dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente che offre prodotti equivalenti deve fornire una prova idonea a dimostrare l'equivalenza allegata", in assenza della quale è legittima l'automatica esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica.

In ossequio a tale principio, quindi nell'offerta deve essere data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche".

Nel campo documentazione amministrativa dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, comprensiva della dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione dei nn.iscrizione INPS e INAIL, sedi e numero dei dipendenti o copia del DURC come da allegato (modello B), inserito nella documentazione richiesta;
- Patto d'integrità anticorruzione;
- Dichiarazione cc dedicato.

Nel campo documentazione tecnica dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

- Descrizione dell'attrezzatura offerta con indicazione di marca, modello e nome della ditta produttrice;
- Scheda tecnica dei prodotti offerti, depliant;
- Documentazione attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24 Febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni in attuazione Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici (Dichiarazioni del fabbricante o certificazioni di conformità rilasciate dal laboratorio ed ente indipendente);
- Descrizione garanzia offerta, – durata minima 24 mesi - full risk su tutti gli inconvenienti, di qualsiasi natura, che si dovessero riscontrare durante il periodo di garanzia con l'obbligo di eliminazioni;
- Dichiarazione con la quale le ditte partecipanti alla procedura di gara, ove richiesta, si impegnano a fornire demo delle attrezzature offerte;
- Dichiarazione relativa alla formazione gratuita, in favore del personale sanitario utilizzatore dei beni in argomento, per il tempo necessario all'apprendimento.

Nel campo offerta economica dovranno essere inseriti, completi in ogni singola voce, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- P.N.
- Offerta economica come generata dal sistema con indicazione del prodotto offerto, marca, modello e nome della ditta produttrice e il prezzo complessivo per l'intero lotto, IVA esclusa;
 - Offerta economica dettagliata indicante i prezzi unitari IVA esclusa, sconto applicato e l'importo complessivo, come da modello allegato;
- Il prezzo dovrà comprendere: consegna, messa in funzione, collaudo e quant'altro connesso alla fornitura.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione:

- La formalizzazione del rapporto contrattuale avverrà attraverso la stipula del contratto nei modi e nelle forme di legge da registrare solo in caso d'uso.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- All'atto della formalizzazione del rapporto contrattuale andrà versato il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore della fornitura IVA esclusa, da costituirsi ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..


- **la fornitura dovrà essere eseguita a seguito di esplicito ordine informatico (N.S.O.);**
- **consegna delle apparecchiature entro 20 gg. lavorativi dall'emissione dell'ordine informatico (NSO) presso il Magazzino Economico del P.O. "Chiello" di Piazza Armerina.**

L'attività di consegna dell'apparecchiatura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, messa in funzione e asporto dell'imballaggio. Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall'Amministrazione. Le apparecchiature devono essere consegnate unitamente alla manualistica d'uso in lingua italiana sia in formato digitale che in formato cartaceo.

Al termine delle operazioni di consegna e, comunque, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa, il Fornitore dovrà procedere alle operazioni di installazione, messa in funzione e collaudo sia delle apparecchiature che degli eventuali dispositivi opzionali, pena l'applicazione delle penali. Nell'installazione è compreso il collegamento della fornitura alla rete elettrica dell'Amministrazione.

- I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 93/42 CEE e nella Guida CEI 62-122 e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo deve essere effettuato in contraddittorio con l'ASP, alla presenza del Sanitario utilizzatore, di un tecnico incaricato dall'Azienda e dalla Ditta affidataria;
- In tale sede il Fornitore dovrà produrre la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza delle apparecchiature fornite alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature o quant'altro dovesse rendersi necessario ai fini del collaudo. Il collaudo in uso clinico, con esito positivo, non solleva comunque il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi. Qualora i beni consegnati non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni


Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Il Fornitore per i primi 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data del collaudo positivo dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sulle apparecchiature e gli eventuali dispositivi opzionali ordinati. Sono comprese nel servizio di assistenza e manutenzione la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura comprensiva di accessori, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es. materiale monouso e monopaziente). Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione in permuta, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da dolo da parte dell'Amministrazione. **Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità e quantità.**

Penalità e danni

- Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna del bene oggetto del presente contratto. In caso di ritardo, l'ASP, a suo insindacabile giudizio, e con riserva di addebito di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico del fornitore una penale nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Le penali non potranno, comunque, superare, complessivamente, il 10% del suddetto importo netto contrattuale. L'eventuale importo dovuto sarà detratto senza alcuna particolare formalità da quello della liquidazione finale, e/o dalla consegna definitiva fatti salvi eventuali danni che questa Azienda potrebbe subire per effetto della ritardata consegna. Tuttavia l'impresa qualora per cause ad essa non imputabili, non fosse in grado di completare le forniture entro il termine prestabilito, avrà la possibilità di chiedere con domanda motivata, prima della scadenza del termine stesso, un congruo periodo di proroga.
- **Pagamento: entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della fattura che dovrà pervenire dopo il ricevimento e collaudo, con esito positivo, dei beni forniti, le verifiche di Legge delle forniture e gli adempimenti amministrativi;**
- Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà dell'impresa, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati e, perciò influenti nelle forniture e nelle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate o documentate.
- Il controllo sulla quantità e qualità delle attrezzature e dei prodotti forniti spetta al Direttore dell'esecuzione del contratto, anche su segnalazione dell'U.O. utilizzatrice; in ogni caso, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare sull'apparecchiatura consegnata idonea garanzia da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore; in caso di merce contestata, in quanto ritenuta non conforme,

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

la ditta è obbligata, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione della stessa non conforme, entro 10 giorni dalla contestazione.

- In caso contrario, saranno applicate le penali sopra previste. Il regolare utilizzo dell'apparecchiatura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'Azienda può chiedere la risoluzione del contratto, nei seguenti casi:

- a) fornitura di prodotti difformi dai requisiti tecnici richiesti e contestati oltre la seconda volta;
- b) ritardo nella fornitura totale o parziale reiterato oltre la seconda volta;
- c) mancata sostituzione dei prodotti contestati reiterata oltre la seconda volta;
- d) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile;
- e) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo;
- f) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- g) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- h) nei casi di cessione e di subappalto non autorizzati dall'Azienda;
- i) nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- j) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini prescritti;
- k) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche in corso di esecuzione;
- l) in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidataria, l'Azienda ha diritto di incamerare, ove previsto, il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, anche in danno dell'inadempiente.

Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile, il Direttore Generale potrà, a suo insindacabile giudizio, non stipulare alcun contratto, nel caso in cui non ritenga meritevoli di approvazione e/o convenienti, sotto il profilo tecnico-economico, i risultati dell'attività negoziale.

E' fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, etc.), che potrà essere attivato senza che le concorrenti possano avanzare richieste di risarcimento od altro.

E' fatto espresso **divieto di cessione del credito**, fatta salva l'esistenza di carenza di liquidità che non consenta il rispetto dei termini di pagamento.

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in relazione al contratto di cui alla presente procedura, è competente esclusivamente il Foro di Enna.

La Fattura dovrà essere intestata a: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA V.LE DIAZ, 7/9 – 94100 – ENNA – P.I. 01151150867

IVA: a carico dell'A.S.P.

SEGUE ALLEGATO "A"

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Francesco Iudica



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

ALLEGATO A

LOTTO 1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DI N. 8 VENTILATORI A PRESSIONE POSITIVA AUTOMATICI CON ALGORITMO AUTOSET DA DESTINARE ALLA U.O.C. MEDICINA GENERALE P.O. “CHIELLO” DI PIAZZA ARMERINA.

Ventilatore a pressione positiva automatico con algoritmo AutoSet™ per la titolazione e per il trattamento di pazienti affetti da Apnee Ostruttive nel Sonno (OSAS).

Dotato di tecnologia di trasmissione-ricezione dati in modalità wireless (senza fili) su rete GSM.

Algoritmo AutoSet™ potenziato, validato clinicamente per la risposta in automatico a Limitazione di Flusso,

Russamento ed Apnea Ostruttiva, con distinzione dei tipi di Apnee.

Tecnologia “F.O.T.”™ (Forced Oscillation Technology) in grado di distinguere le Apnee Centrali dalle Apnee

Ostruttive con miglioramento delle risposte pressorie e trattamento adeguato dei singoli eventi.

Calcolo automatico di perdite intenzionali su fori di esalazione maschera con selezione dell'interfaccia dal menù di impostazioni.

Pressioni operative da 4 a 20 cmH2O

Caratteristiche tecniche:

- Modalità di funzionamento: Auto CPAP - CPAP
- Selezione delle interfacce: Tipo di maschera
- Tipologia di ventilazione: Non Invasiva
- Pressioni erogate: da 4 a 20 cmH2O
- Algoritmo AutoSet per il trattamento degli eventi ostruttivi: limitazione di flusso - russamento - apnea
- Regolazione manuale tempo di rampa (CPAP) per il raggiungimento della pressione terapeutica
- Regolazione manuale tempo di stabilizzazione (AutoSet) per il raggiungimento della pressione terapeutica
- Regolazione automatica tempo di stabilizzazione (AutoSet) con rilevamento dell'addormentamento del paziente
- Compensazione automatica dell'altitudine
- Display LCD a colori per la visualizzazione diretta dei seguenti parametri:
 - Impostazioni
 - Modalità in uso
 - Pressioni erogate
 - Perdite in Litri/Minuto
 - Indice di Apnea/Ipapnea
 - Indice di Apnea
 - Dati di efficacia e dati di utilizzo
 - SpO2 e Frequenza Cardiaca (con modulo opzionale)

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Menù Paziente (base e avanzato)
- Utilizzo del dispositivo (giornaliero-mensile-trimestrale-semestrale-annuale) con contatore e indici di compliance
- Opzioni
- Programmazione di Promemoria per il Paziente anche ad intervalli ripetuti, da 1 a 24 mesi (sostituzione maschera – sostituzione filtro – chiamata medico – inserimento scheda memoria – chiamata tecnico – promemoria personalizzabile).
- Memoria interna di 365 sessioni che possono essere visualizzate sul dispositivo, ResScan™ e in wireless mediante AirView™ e 30 sessioni di dati dettagliati ad alta risoluzione visualizzabili su computer attraverso il software dedicato ResScan™, con gestione cartella clinica del paziente, follow up, programmazione visite di controllo, ecc.
- Funzione Smart Start™ sospende/riprende la terapia quando viene rilevata la disconnessione/connessione della maschera dal viso del paziente
- Funzione A.E. (Aiuto Espiratorio) provvede ad abbassare la pressione erogata in fase espiratoria (-1 / -2 / -3 cmH₂O) per migliorare il comfort e la compliance del paziente
- Funzione di compensazione automatica delle perdite con risposta di compensazione fino ad 1 litro al secondo di perdite non intenzionali.
- Sistema di umidificazione opzionale integrato e riscaldato HumidAir™ con Climate Control™ per la regolazione (automatica o manuale) della temperatura e del livello di umidificazione. Circuito paziente opzionale Climate LineAir™, riscaldato e dotato di sensori di temperatura per l'erogazione in automatico dell'85% di umidità relativa. Sistema di protezione anti-condensa, anche ad altissimi livelli di umidificazione.
- Alimentazione elettrica 110/220 Volt con possibilità (opzionale) di utilizzo con alimentazione a 12/24 Volt
- Batteria esterna opzionale ResMed PowerStation II™.
- Apparecchiatura conforme alle normative Internazionali IEC 601.1, classe II tipo BF, realizzato in conformità con la Direttiva Comunitaria 93/42/EEC (CE).
- Livello di emissioni sonore 27dBA, livello di pressione a 1 metro 13dBA
- Dimensioni in millimetri: Altezza 116 - Larghezza 255 - Profondità 150 (con HumidAir)
- Peso: Kg. 1,115
- Condizioni ambientali: temperatura di esercizio tra +5 e +40°C - Umidità di esercizio 15-95% non condensante - Temperatura di stoccaggio e trasporto tra -20 e +60° C - Umidità di stoccaggio e trasporto fino al 95% non condensante
- Fornito di borsa per il trasporto per apparecchiatura ed accessori.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA € 6.000,00 OLTRE IVA 22%

CIG:

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

LOTTO 2

sub. a) – CARATTERISTICHE TECNICHE DI N. 4 VENTILATORI POLMONARI PER LA VENTILAZIONE NON INVASIVA PER PAZIENTI ADULTI E PEDIATRICI (MAGGIORI O UGUALI A 20 KG.) DA DESTINARE ALLA U.O.C. MEDICINA GENERALE DEL P.O. “CHIELLO” DI PIAZZA ARMERINA.

Specifiche tecniche

1. Tipi di paziente

Adulti
Pediatrici (≥ 20 kg)

2. Modalità/ terapia

Standard
HFT (ossigenoterapia ad alti flussi)
CPAP (pressione positiva continua delle vie aeree)
S/T (spontanea/temporizzata)
PCV (ventilazione a pressione controllata)
AVAPS (volume medio garantito in pressione di supporto).
Opzionale

PPV (ventilazione a pressione proporzionale)
Auto-Trak Plus

3. Impostazioni

Impostazioni Intervallo

Flusso (solo HFT) Da 10 a 80 l/min


C-Flex OFF, da 1 a 3

CPAP Da 4 a 25 cmH₂O

EPAP Da 4 a 25 cmH₂O

IPAP Da 4 a 40 cmH₂O

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni – Viale Armando Diaz n. 7/9 – 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA


Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

T insp (tempo inspiratorio)	Da 0,30 a 3,00 s
P max (pressione IPAP max AVAPS)	Da 6 a 40 cmH2O
P min (pressione IPAP min AVAPS)	Da 5 a 30 cmH2O
O2 (percentuale di ossigeno)	Da 21 a 100%
Tempo di rampa	OFF, da 5 a 45 min
Freq. (frequenza respiratoria)	Da 4 a 60 bpm
Salita (tempo di salita)	Da 1 a 5
Trigger e ciclaggio (Auto-Trak)	Adattamento automatico
Volume corrente target AVAPS	Da 200 a 2000 ml BTPS
Max E	Da 0 a 100 cmH2O/I
Max R	Da 0 a 50 cmH2O/l/s
% PPV	Da 0 a 100%
P max (limite pressione PPV massimo)	Da 5 a 40 cmH2O
V max (limite volume PPV massimo)	Da 200 a 3500 ml

4. Modalità/ terapia e impostazioni

	CPAP	S/T	PCV	AVAPS	PPV	HFT
F req.		•	•	•	•	
T insp		•	•	•	•	
CPAP	•					
EPAP		•	•	•	•	
IPAP		•	•		•	
Salita		•	•	•	•	
P min				•		
P max				•	•	
V max					•	



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 01151150867
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

	CPAP	S/T	PCV	AVAPS	PPV	HFT
Max E					•	
Max R					•	
% PPV					•	
O2	•	•	•	•	•	•
VT (volume corrente)				•		
C-Flex	•					
Tempo di rampa	•	•	•			
Flusso						•

5. Parametri monitorati

Finestra dati paziente

Fase respiro/indicatore trigger	Spont., Temp., Espiraz.
PIP	Da 0 a 50 cmH2O
Perd. paz./Perd. tot.	Da 0 a 200 l/min BTPS
Trig. paz.	Da 0 a 100%
Frequenza respiratoria	Da 0 a 90 BPM
Ti/Ttot	Da 0 a 91%
Volume minuto	Da 0 a 99,0 l/min BTPS
Volume corrente	Da 0 a 3500 ml BTPS

Finestra delle forme d'onda

Forma d'onda della pressione	Da 0 a 50 cmH2O
Forma d'onda del flusso	Da -240 a 240 l/min BTPS
Forma d'onda del volume	Da 0 a 3500 ml BTPS

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
 Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
 U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

6. Allarmi

Allarme Intervallo regolabile

Freq. Alta (Allarme alta frequenza)	Da 5 a 90 BPM
Freq. Bassa (Allarme bassa frequenza)	Da 1 a 89 BPM
VT Alto (Allarme volume corrente alto)	Da 200 a 3500 ml
VT Basso (Allarme volume corrente basso)	OFF, da 5 a 1500 ml
PIA (Allarme pressione inspiratoria alta)	Da 5 a 50 cmH2O
PI Bassa (Allarme pressione inspiratoria bassa)	OFF, da 1 a 40 cmH2O
VE Basso (Allarme ventilazione minuto bassa)	OFF, da 0,1 a 99 l/min
tPI Bassa (Ritardo di allarme pressione inspiratoria bassa)	Da 5 a 60 secondi

7. Altre impostazioni

Livello acustico degli allarmi	Da 1 a 10 (scala relativa)
Luminosità	Da 1 a 5 (scala relativa)

Selezione porta espiratoria • DEP (porta espiratoria monouso)
 • Whisper Swivel
 • PEV (valvola espiratoria di plateau)
 • Altro
 • Nessuna (nessuna porta espiratoria nel circuito)

Selezione interfaccia	ET/Trach, 1, 2, 3, Altra
Blocco schermo	Spento, Acceso
Auto-Trak Plus	Opzionale
Trigger	Normale, da 1 a 7
Ciclo E	-2, -1, Normale, da 1 a 6



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

8. Specifiche ambientali

Temperatura	
Di esercizio	Da +5 a +40 °C
A magazzino	Da -20 a +50 °C
Umidità relativa	
Di esercizio	Da 15 a 95%
(senza condensa)	
A magazzino	Da 10 a 95%
(senza condensa)	

Pressione barometrica	
In funzione	Da 79,9 a 101,1 kPa
(da 600 a 765 mmHg) Altitudine	
In funzione	Da 600 a 765 mmHg
(da -61 a 1951 m circa rispetto al livello del mare)	

9. Comunicazione

Philips IntelliBridge EC10
Philips IntelliBridge EC40/80
Philips VueLink Open Interface
Sistema di diagnostica a distanza Respi-Link
Sistema di gestione Bernoulli®
Driver di interfaccia del dispositivo Capsule DataCaptor™
GE Healthcare (Centricity™ Critical Care)
Cerner CareAware® iBus™
Altri sistemi di monitoraggio e di gestione dei dati paziente
RS232 digitale e analogica

10. Specifiche elettriche

Alimentazione esterna	
Tensione CA	Da 100 a 240 VCA
Frequenza CA	50/60 Hz

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
ENNA

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

Alimentazione CA	300 VA
Batteria (opzionale)	
Tensione nominale	14,4 V
Capacità 11,0 Ah	
Tipo di batteria	Ioni di litio
Autonomia 6 ore in condizioni normali	

11. Specifiche fisiche

Peso
11,7 kg con batteria opzionale
10,6 kg senza batteria opzionale

Dimensioni
Altezza: 33,7 cm
Larghezza: 39,4 cm
Profondità: 42,9 cm

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 40.000,00 OLTRE IVA 22%

sub. b) – CARATTERISTICHE TECNICHE DI N. 4 MONITOR PAZIENTE INTEGRATO CON IL VENTILATORE POLMONARE PER LA VENTILAZIONE NON INVASIVA E I 4 MONITOR DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DI FUTURA ACQUISIZIONE, DEVONO POSSEDERE LE STESSA CARATTERISTICHE TECNICHE PER ESSERE COLLEGATI IN RETE CON IL SISTEMA DI MONITORAGGIO PAZIENTE AVANZATO, DOTATO DEL PROTOCOLLO DI ALLARME NOTIFICA, DENOMINATO EARLY WARNING SCORES (EWS) DA DESTINARE ALLA U.O.C. MEDICINA GENERALE DEL P.O. "CHIELLO" DI PIAZZA ARMERINA.

Specifiche:

- Display touchscreen dimensioni ridotte circa 8,4" (max +10%); visualizzazione fino a 5 forme d'onda; sensore di luce ambientale regolazione luminosità automatica dello schermo; maniglia e vano portamoduli integrato;
- Modulo multiparametrico Plug and Play, deve fornire i dati relativi alla misurazione dei parametri di seguito elencati: elettrocardiogramma cavo 5 poli (ECG)/aritmia, respiro (RR), saturazione ossigeno nel sangue arterioso (SpO2) tecnologia Masimo Rainbow, Pressione non invasiva (NIBP) e temperatura;

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711



Regione Siciliana
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
E N N A

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01151150867
U.O.C. Servizio Provveditorato/ U.O.S. Gare Beni

Responsabile del Procedimento Tel. 0935/520131 - Responsabile U.O.S. Gare Beni 0935/520711

- Interfacce integrate RS232 per interfacciamento di dispositivi medicali esterni (collegamento ventilatore polmonare, in dotazione al reparto), e visualizzazione parametri alla centrale di monitoraggio; porte USB per il collegamento di tastiera alfanumerica, mouse, lettore di codici a barre;
- Funzionamento a rete e batteria estraibile ricaricabile, autonomia 4 ore;
- Funzionalità di rete wireless;
- Rilevamento dei valori digitali elettrofisiologici, adattabile ai protocolli utilizzati, dotato di campi personalizzabili, automatizzazione del calcolo EWS: pressione sanguigna non invasiva, SpO2, Polso, frequenza respiratoria, Pattern respiratorio, temperatura, livello di coscienza del paziente AVPU, dolore.
- Configurabilità impostazioni, parametri, allarmi, gestione di almeno 3 protocolli personalizzabili di Early Warning Score (EWS), deve consentire agli operatori sanitari l'accesso diretto a un sistema di punteggi automatizzato basato sulle procedure e linee guida aziendali. In funzione del livello di gravità del paziente e la frequenza di acquisizione dei parametri vitali, EWS deve consentire di rilevare precocemente un eventuale peggioramento del paziente tramite semplici e rapidi calcoli del punteggio Early Warning Score, che tramite rete wireless verranno trasmessi alla centrale di monitoraggio.
- Funzione SRR (short radio range) per acquisizione parametri da device cableless.
- Espandibilità protocollo SEPSI.
- Carrello dedicato dotato di sistema per aggancio/sgancio rapido del monitor multiparametrico.

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA €. 34.000,00 OLTRE IVA 22%

IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA LOTTO 2: €. 74.000,00 OLTRE IVA 22%

CIG:

U.O.C. Servizio Provveditorato/U.O.S. Gare Beni - Viale Armando Diaz n. 7/9 - 94100 Enna
Tel. 0935/520131 - 520711

- se s.a.s.:

- che i soci accomandatari sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- se altro tipo di società o consorzio:

- che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza sono:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il direttore tecnico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che il socio unico è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____


- che il socio di maggioranza, se società con meno di quattro soci, è:

_____ nato il _____ a _____ Cod. fisc. _____

- che la ditta/società/consorzio/cooperativa _____ :

partecipa come impresa singola;

in caso di associazione, raggruppamento di imprese o consorzio:


2

partecipa come mandataria capogruppo dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

partecipa come mandante dell'associazione, raggruppamento di imprese o consorzio _____;

1. Che la ditta _____ risulta essere iscritta alla CC.I.AA. di _____ o nel registro professionale o commerciale di stato membro per i non residenti in Italia, nella categoria equivalente all'oggetto della contrattazione al n. _____ cod. attività _____;
2. Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, non hanno pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31/05/1965 n.575, sostituito con l'art.3 della legge 19 marzo 1990, n°55;
4. Che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci Accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società, e i soggetti cessati dalla carica (indicare i soggetti) nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera invito, non hanno riportato sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì, riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (indicare cognome, nome, luogo, data di nascita e incarico societario);


5. Che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o che, nell'esercizio della propria attività professionale, non ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla Amministrazione aggiudicatrice;
6. che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;
7. Che la Ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita ed è regolarmente iscritta alle seguenti posizioni dei registri:

INPS sede di _____ N. _____ dal _____

INAIL sede di _____ N. _____ dal _____


Dichiara inoltre la propria regolarità contributiva essendo in perfetto ordine con i pagamenti dei contributi dovuti e che nulla osta al rilascio del DURC.

8. Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere in possesso della certificazione di cui art. 17 della L. 68/99, ovvero di non essere soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);
9. Di non avere riportato sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2, lett. C), del D.lgs n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
10. Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art.17 della legge 55/1990;
11. Che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni ostative previste dall'art.80 D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii.;
12. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e si impegna in caso di assegnazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.;
13. Che la ditta è in possesso della necessaria capacità tecnica e si impegna in caso di aggiudicazione, se richiesto, a comprovare tale capacità in uno dei modi previsti dall'art. 83 del Dlgs.50/16 e ss.mm.ii.;



14. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato, né si accorderà, con altri partecipanti alla gara;
15. Di avere preso visione della lettera di invito e capitolato e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole in essa contenute;
16. Di impegnarsi ai sensi del D.P.R.445/00 ad Osservare il Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62/2013, il Codice di comportamento aziendale e la Carta etica aziendale, e ad accettare, inoltre, la clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto con questa A.S.P. in caso di violazione degli obblighi derivanti da tali Codici;
17. Di accettare l'applicazione di interessi moratori più favorevoli, rispetto ai tassi di riferimento previsti dal D.Lgs. 231/02;
18. Che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato alle altre Aziende Sanitarie;
19. Che il prezzo è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retribuite previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
20. Che l'offerta presentata ha una validità di 180 giorni lavorativi dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
21. Indicazione dello status posseduto dalla ditta concorrente rispetto al prodotto offerto (produttore/distributore/rivenditore/importatore etc);
22. Che i prodotti offerti rispondono ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti in vigore all'atto dell'offerta ed a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura;
23. Che i prodotti offerti, sono costruiti a perfetta regola d'arte, sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, e sono in possesso del marchio CE;
24. Di aver preso visione dei locali e di aver valutato tutti gli elementi che possano influire sulla determinazione del prezzo
25. Di impegnarsi a fornire i pezzi di ricambio per almeno 10 anni dalla data di collaudo;
26. Di accettare che il relativo pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica del regolare funzionamento delle macchine e collaudo con esito positivo;

27. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Codice in materia di protezione di dati personali", il trattamento dei dati forniti.
28. Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a:
- a) denunciare alle Autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso di esecuzione, del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti, e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;
 - b) rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - c) di essere a conoscenza che la violazione, debitamente accertata, dei superiori punti 1 e 2 costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 del c.c.;
 - d) di impegnarsi al rispetto delle previsioni di cui alla Legge regionale 15/08.
 - e) di ottemperare all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n° 136 del 13.08.2010 come modificato e integrato dall'art.7 della L. 12.11.2010 n° 187 e di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. n° 15/2008 come modificato e integrato dall'art.28, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n° 6/2009 e pertanto di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e di tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale;
29. Di essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
30. In caso di RTI e consorzi d'impresa di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conformarsi alla disciplina vigente ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii;
31. Il DUVRI è pari a zero;
32. Di accettare, ai sensi dell'art.23 del Dlg. 30/06/2003, n.196 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali" e ss.mm.ii., il trattamento dei dati forniti;
33. Di accettare, nel caso di reclamo formale dell'Azienda Sanitaria Provinciale pervenuto entro 30 gg. dalla data di consegna, di sostituire la merce consegnata nel caso di imperfezioni dovute alla fabbricazione ovvero al trasporto della merce.


6

34. di accettare tutte le condizioni della lettera d'invito, degli allegati e delle eventuali richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte;

Li _____

Timbro e Firma Leggibile

N. M.



Bum

PATTO DI INTEGRITÀ' TRA L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA E I PARTECIPANTI ALLA GARA

Questo documento, approvato contestualmente agli atti di gara dal Direttore Generale di questa Azienda, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in argomento, costituisce parte integrante della presente gara d'appalto e di qualsiasi contratto assegnato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna impiegati ad ogni livello nell'espletamento della presente gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la gara: l'elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l'elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto il vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.

Il sottoscritto Operatore economico

nato ail.....

residente in.....Via.....

Codice Fiscale n.....

In qualità di

dell'Impresa iscritta al n.....del Registro delle imprese della Camera di

Commercio di....., Partita Iva.....

in qualità di eventuale affidataria delle forniture in oggetto o aggiudicataria o subappaltatrice, si impegna a segnalare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara .

Il sottoscritto Operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito delle gare in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Codice Fiscale e partita IVA 01151150867

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

1. risoluzione o perdita del contratto;
2. escussione della cauzione di validità dell'offerta;
3. responsabilità per danno arrecato all'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna nella misura dello 1% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
4. esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per due anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data _____

Il Direttore U.O.C. Servizio Provveditorato
Dott.ssa .Maria Concetta Perna

Titolare o legale rappresentante

della Ditta.....

(timbro e firma)

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna
Il Direttore Generale

AIF ASP ENNA
Viale Armando Diaz, 7/9
94100 Enna EN

MODELLO PER COMUNICAZIONE DI LEGGE 136/2010 "TRACCIABILITA' DEI FLUSSE FINANZIARI"
G.L.G.

RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA I.V.A.	
INDIRIZZO	
TELEFONO/FAX	

Il soggetto di cui sopra, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

DICHIARA

- che gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti dei contratti stipulati con ASP di Enna sono:

Estremi identificativi del conto corrente:

CODICE IBAN	
INTESTATO A	

Generalità delle persone delegate ad operare su di esso:

COGNOME E NOME	
COD. FISCALE	

N.B.: si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti ed altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vi è l'obbligo di comunicarli tutti.

- che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il conto corrente dedicato sopra indicato;
- di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- che, in caso di variazione del conto corrente, ne sarà data tempestiva comunicazione.

Data

.....
 (Timbro e Firma)

MEDIANTE APPOSIZIONE DI TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE SI AUTORIZZA ANCHE IL TRATTAMENTO E L'UTILIZZO DEI DATI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003.

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario oltre IVA</i>	<i>Totale oltre IVA</i>
1	Ventilatore a pressione positiva automatico con algoritmo AutoSet	8	€ 750,00	€ 6.000,00
2	sub a) Ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici .	4	€ 10.000,00	€ 40.000,00
	sub b) Monitor Paziente integrato con il ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva e i 4 monitor del sistema di monitoraggio di futura acquisizione, i quali devono possedere le stesse caratteristiche tecniche per essere collegati in rete con il Sistema di monitoraggio paziente avanzato, dotato del protocollo di allarme notifica, denominato Early Warning Scores (EWS)	4	€ 8.500,00	€ 34.000,00

Totale complessivo base d'asta € 80.000,00 oltre IVA 22%

RITENUTO

che il metodo di acquisizione, che si ritiene più confacente alla fattispecie in esame, la cui spesa presunta da porre a base d'asta è di **€. 80.000,00 oltre IVA del 22%** pari a €. 97.600,00 IVA compresa, ritenuta congrua a seguito di verifica su piattaforma MEPA dei prezzi indicati per la categoria merceologica dei beni in argomento, risulta essere la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire la piena funzionalità della U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" Piazza Armerina) del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., invitando tutte le ditte iscritte abilitate per le categorie merceologiche in argomento, e del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicarsi, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida;

che si potrà fare fronte alla spesa presunta di **€.80.000,00 oltre IVA 22%** (base d'asta) o la minor spesa che potrà essere accertata a seguito dell'esperimento di gara in argomento, con i fondi del PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica", giusta nota dell'Assessorato della Salute, prot. 18989 del 05/04/2022, di ricognizione del Piano Straordinario di Interventi - PO FESR Sicilia 2014/2020-;

che, qualora il suddetto finanziamento non venisse assegnato entro il corrente anno, il costo graverà sul bilancio economico aziendale di competenza e verrà assunto con il successivo provvedimento di aggiudicazione – Progetto 329 – Covid 19.

L'anno duemilaventidue il giorno 04 AGO 2022 del mese di nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Francesco Iudica, nominato con Decreto Presidenziale n. 189/Serv.1/S.G. del 04/04/2019, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sabrina Cillia, e dal Direttore Sanitario, Dott. Emanuele Cassarà, e con l'assistenza del Segretario Verbalizzante _____

VISTI

- ✓ La Legge Regionale 5 /2009 e ss.mm.ii. ;
- ✓ L'Atto Aziendale adottato in via definitiva con delibera n.857 del 12/06/2020, parzialmente modificata con delibera 902 del 19/06/2020;
- ✓ Il Regolamento di organizzazione e funzionamento – Area Amministrativa di questa ASP, adottato con delibera n°829 del 24/10/2016;

VISTI I SEGUENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

- A) Estratto nota prot. 87878 del 30/09/2021 relativa alle richieste d'acquisto indicate in premessa, a firma del Direttore U.O.C. Medicina Generale P.O. "Chiello" Piazza Armerina;
- B) Nota riassuntiva prot. 60697 del 16/06/2022, a firma del Direttore U.O.C. Medicina Generale P.O. "Chiello" Piazza Armerina, con autorizzazione apposta dal Direttore Generale;
- C) Lettera d'invito/Capitolato tecnico;
- D) Modello Autodichiarazione ex DPR 445/2000 (mod.B);
- E) Patto d'integrità anticorruzione;
- F) Modello Offerta economica dettagliata;
- G) Modello Tracciabilità dei flussi finanziari.

DATO ATTO che il Direttore della U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla L. 20 dicembre 1996 n. 639, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della Legge 6 novembre 2012 n. 190 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione – nonché nell'osservanza dei contenuti del Piano aziendale della prevenzione della corruzione 2022/2024;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. **DI INDIRE** procedura aperta, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell'art. 60, comma 1 e comma 3 (considerata l'urgenza dell'acquisizione dei beni in argomento per garantire la piena funzionalità della U.O.C. Medicina Generale del P.O. "Chiello" Piazza Armerina), invitando tutte le ditte iscritte e abilitate per la relativa categoria merceologica, in conformità del Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia, da aggiudicare, attese le caratteristiche standardizzate e definite dal mercato, in base al criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, di cui all'art. 95, comma 4, lett. b), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche in presenza di una sola offerta valida, per la fornitura dei beni descritti nella lettera d'invito/capitolato, da assegnare alla U.O.C. richiedente, come indicato in premessa e di seguito elencati:

<i>Lotto n.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quantità</i>	<i>Prezzo unitario oltre IVA</i>	<i>Totale oltre IVA</i>
1	Ventilatore a pressione positiva automatico con algoritmo AutoSet	8	€ 750,00	€ 6.000,00
2	sub a) Ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva per pazienti adulti e pediatrici	4	€ 10.000,00	€ 40.000,00
	sub b) Monitor paziente integrato con il ventilatore polmonare per la ventilazione non invasiva e i 4 monitor del sistema di monitoraggio di futura acquisizione, i quali devono possedere le stesse caratteristiche	4	€ 8.500,00	€ 34.000,00